


MEDVIE


Date du test: 28/05/2024 13:17:31
 Durée: 4mn 49s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	
SAGNO KOLY-SOUA	
Date de naissance	13/01/1971
Age	53
Société	IBS
ID	24052813143728226

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

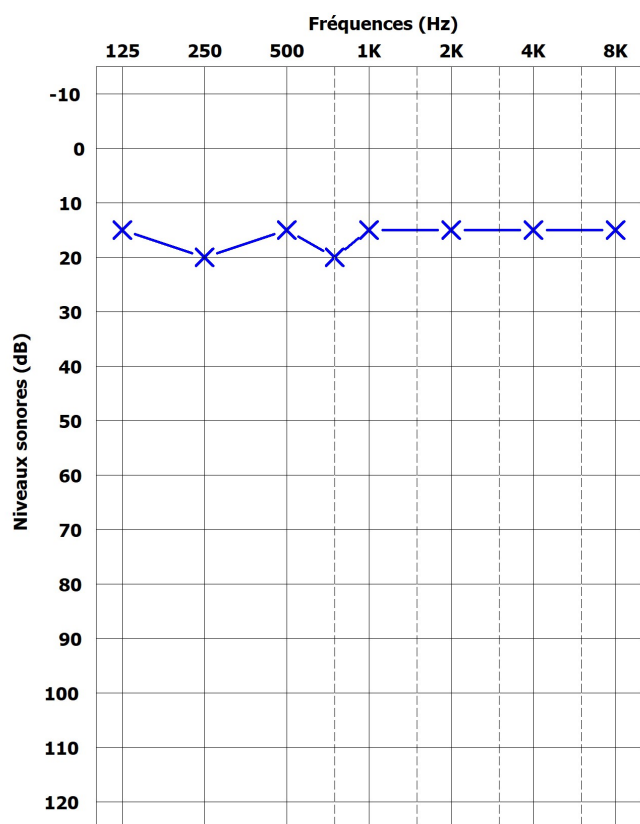

Oreille Gauche

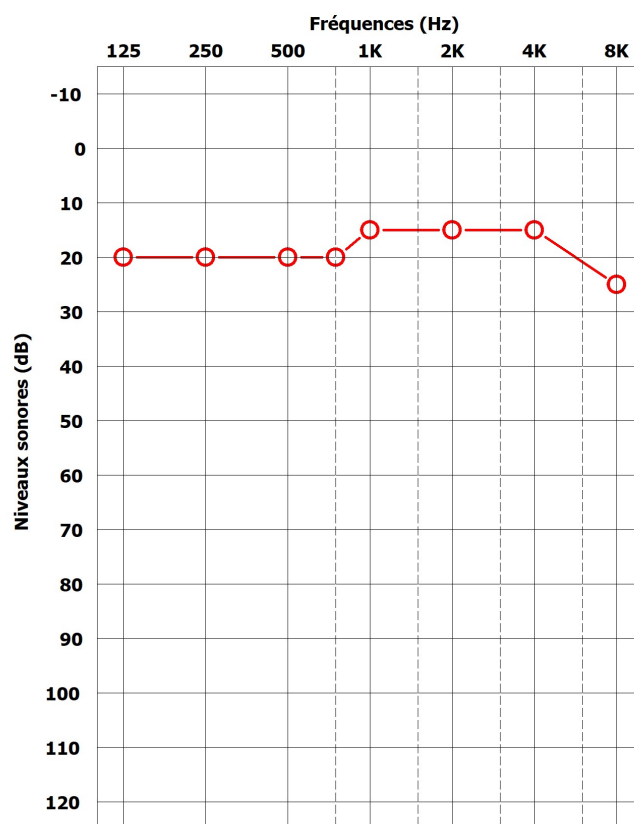

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	15	20	15		15		15		15
CA Droit	20	20	20	20	15		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes