


Données Patient	KEÏTA OUMAR
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	IBS
ID	24051816240182429


MEDVIE

Date du test: 18/05/2024 16:29:23
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

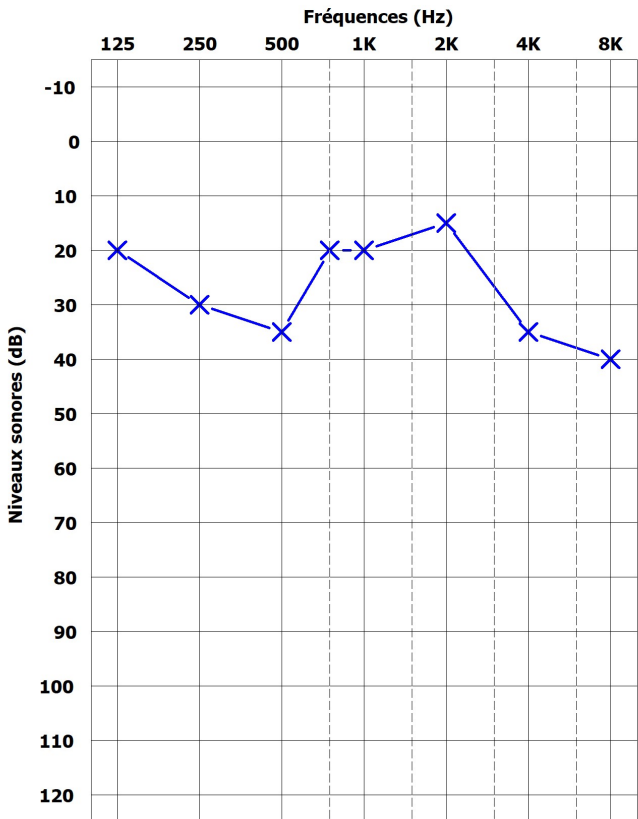

Oreille Gauche

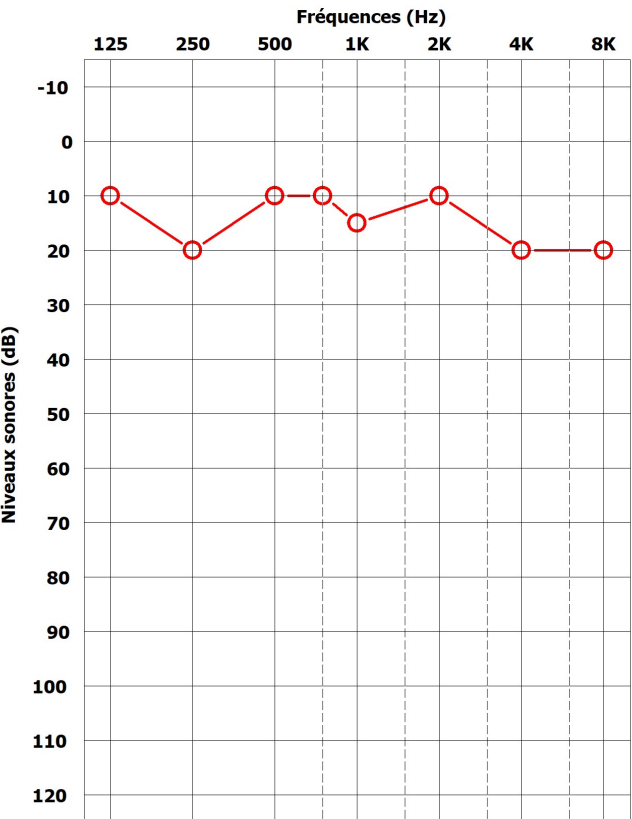

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	30	35	20	20		15		35		40
CA Droit	10	20	10	10	15		10		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes