

MEDVIE


Date du test: 18/06/2025 11:24:54

Durée: 3mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SOW MAMADOU
Date de naissance	22/08/1971	
Age	53	
Société	IBS	
ID	25061811172441543	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

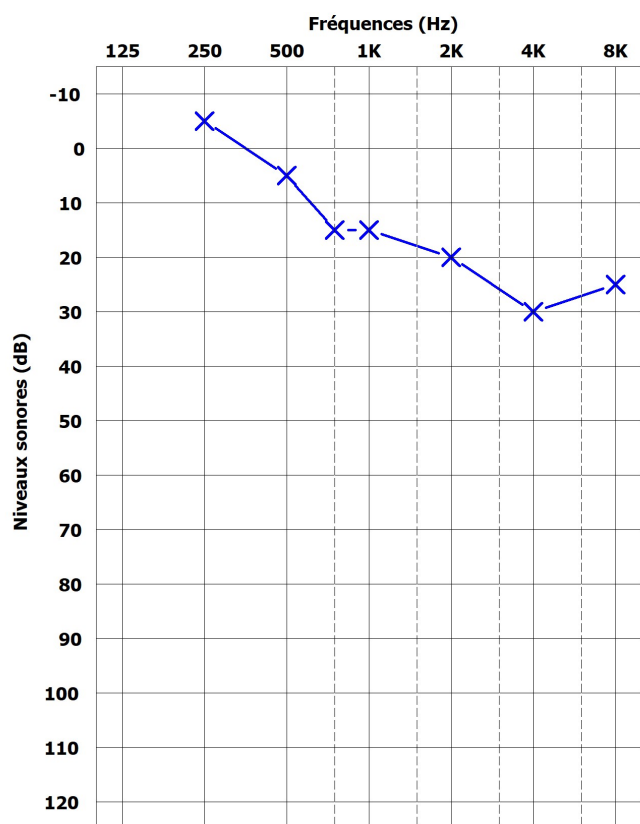

Oreille Gauche

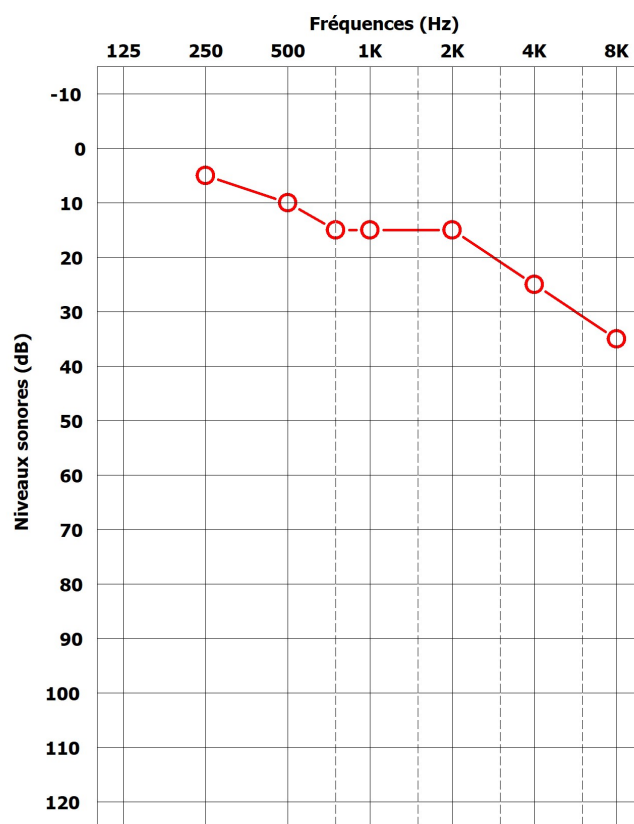

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	15	15		20		30		25
CA Droit		5	10	15	15		15		25		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes