

MEDVIE


Date du test: 05/08/2024 15:38:04

Durée: 4mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SYLLA MOHAMED II
Date de naissance	25/09/1995
Age	28
Société	IBS
ID	24080515350378229

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

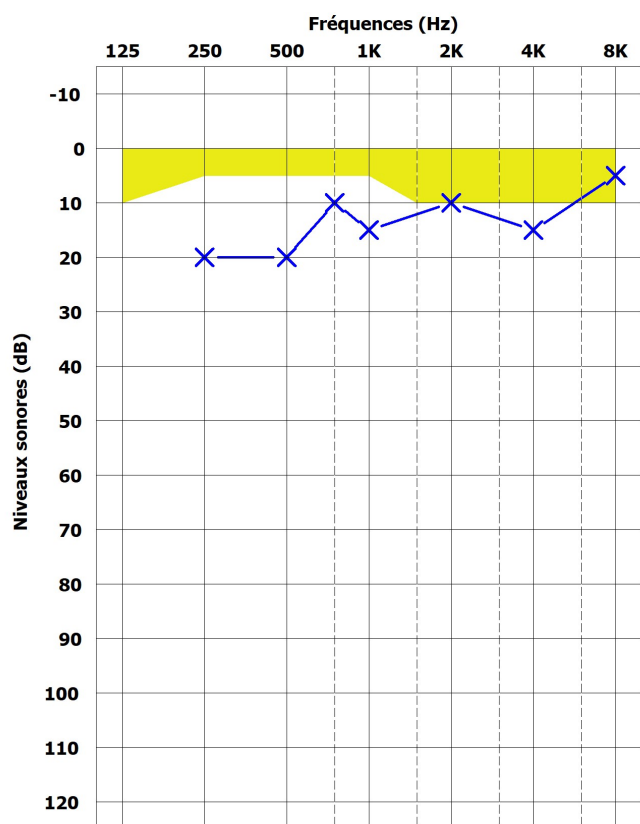

Oreille Gauche

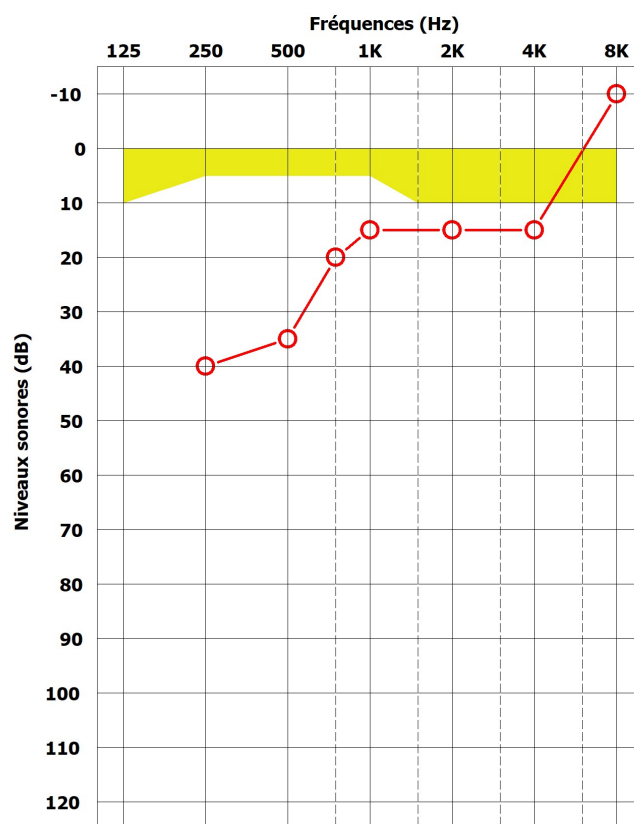

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	10	15		10		15		5
CA Droit		40	35	20	15		15		15		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes