


MEDVIE

Date du test: 24/04/2025 10:54:45

Durée: 5mn 37s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

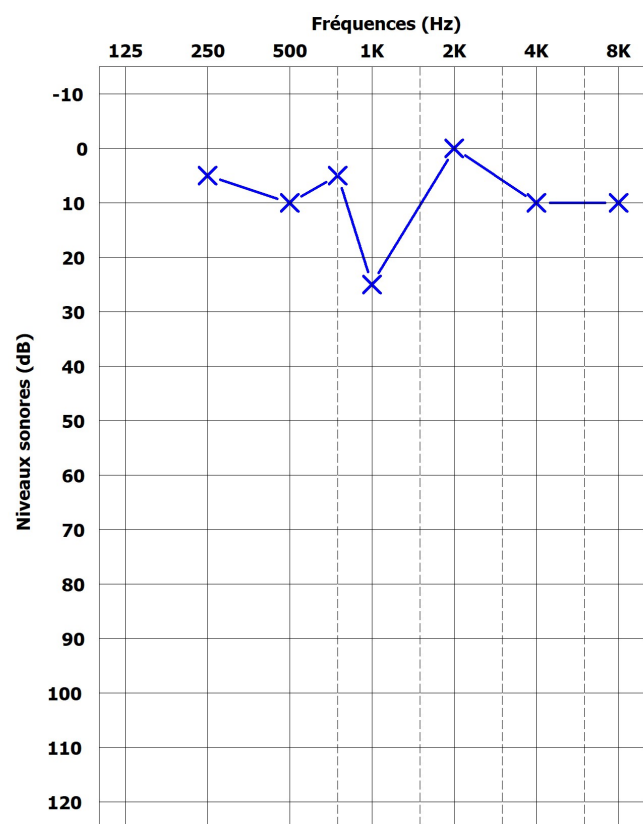

Oreille Gauche

| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| DIALLO AMADOU TIDIANE |                   |
| Date de naissance     | 04/12/1990        |
| Age                   | 34                |
| Société               | IBS GROUPE        |
| ID                    | 25042410441628128 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

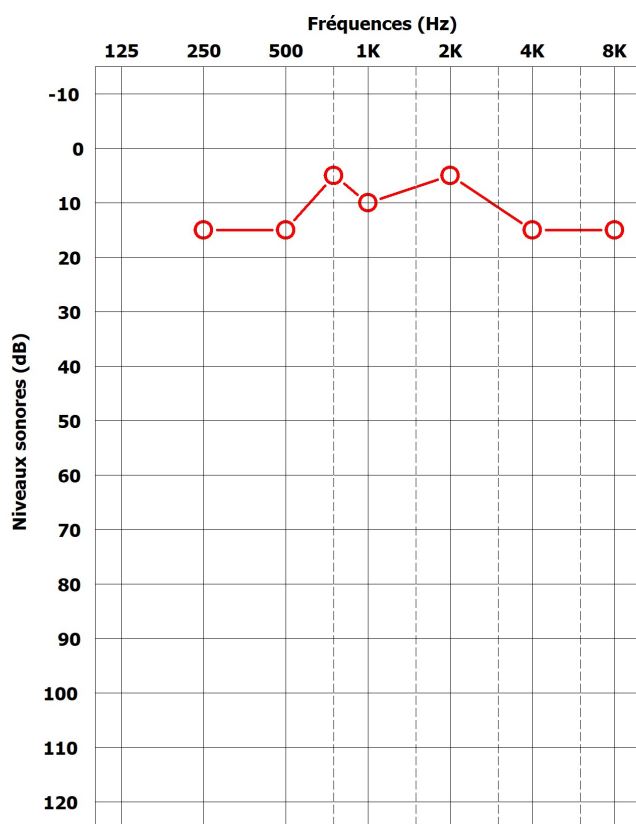

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 10  | 5   | 25 |     | 0  |    | 10 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 15  | 15  | 5   | 10 |     | 5  |    | 15 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 11,3 dB | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes