


MEDVIE


Date du test: 04/08/2025 10:28:43
Durée: 3mn 37s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SIMO YIDJOU ESTELLE	
Date de naissance	23/03/1990
Age	35
Société	IBS
ID	25080410035391684

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

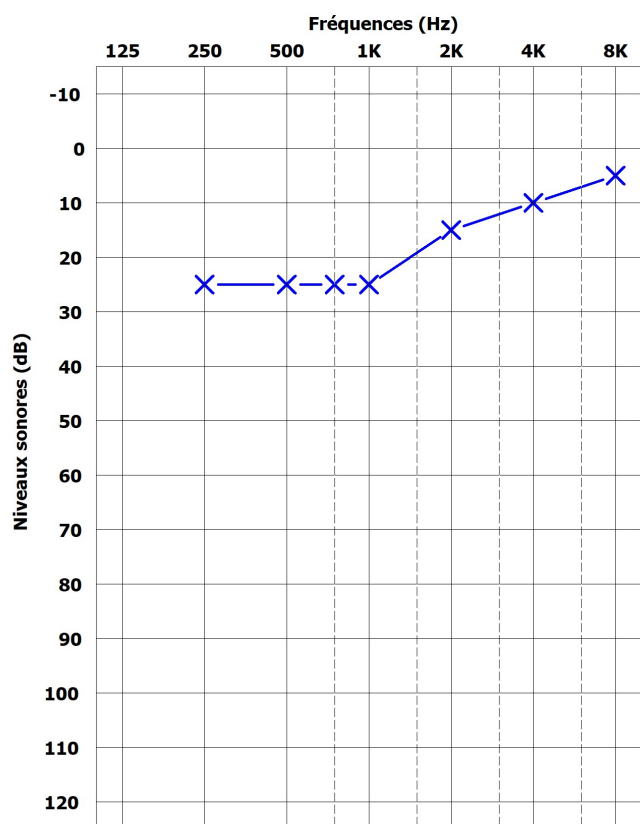

Oreille Gauche

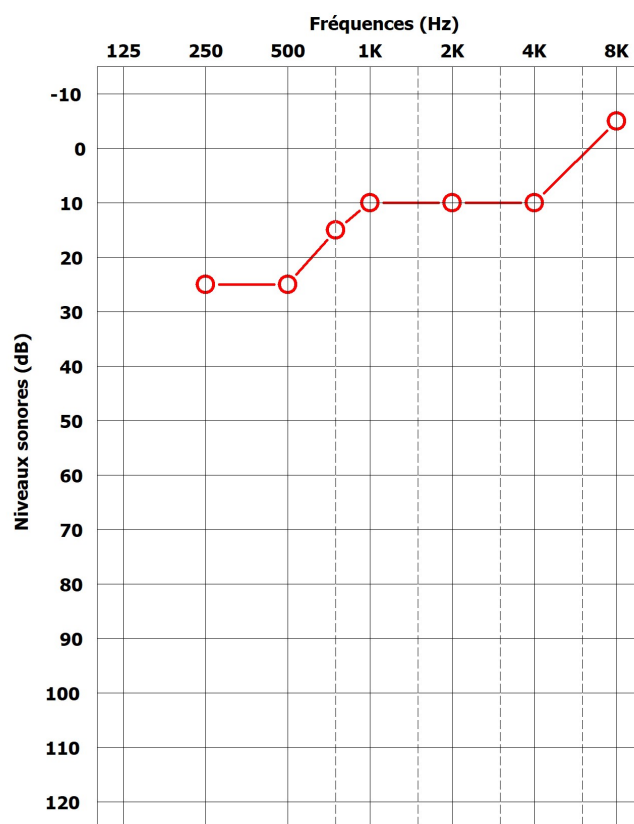

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	25		15		10		5
CA Droit		25	25	15	10		10		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes