



Données Patient	
DOVOEDO HANDEL	
Date de naissance	27/05/1986
Age	38
Société	IBS
ID	25050213183790228

Date du test: 02/05/2025 13:24:02
Durée: -- mn -- s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

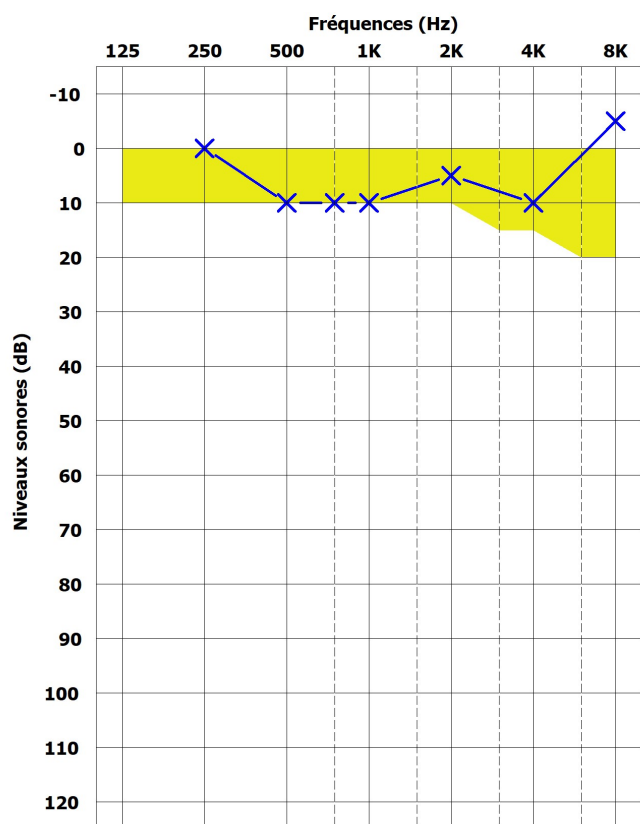

Oreille Gauche

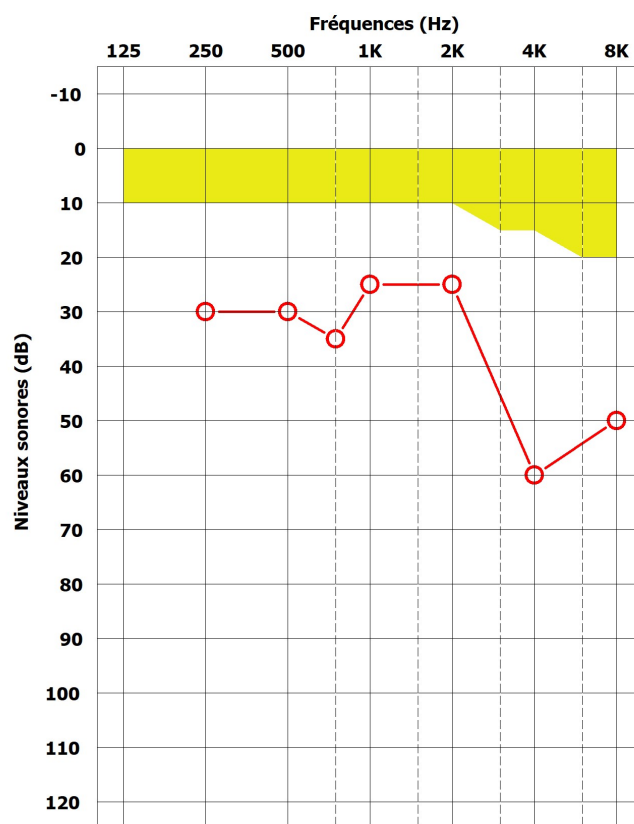

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	10		5		10		-5
CA Droit		30	30	35	25		25		60		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	35,0 dB	---

Notes