

MEDVIE


Date du test: 27/08/2024 15:13:01

Durée: 5mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF AICHA	
Date de naissance	27/05/1997
Age	27
Société	IBS
ID	24082715002286265

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

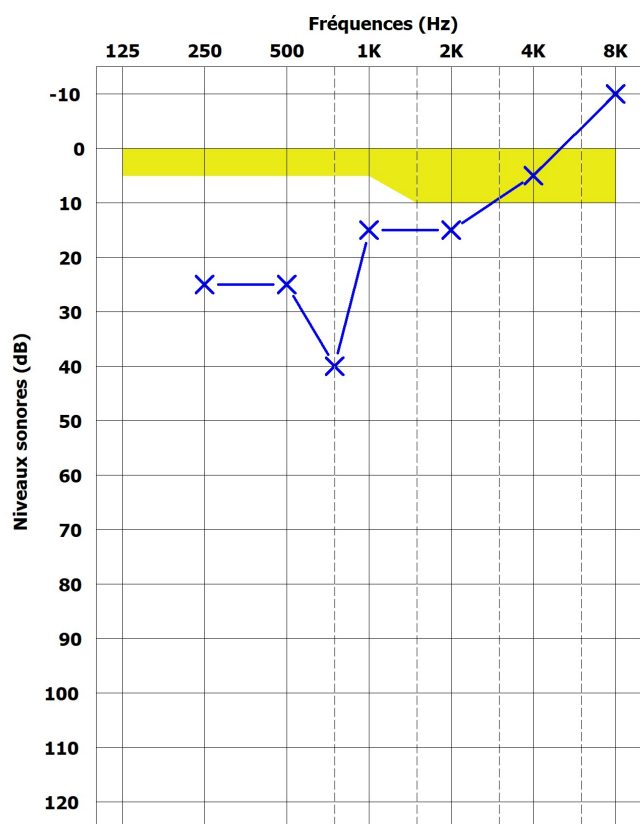

Oreille Gauche

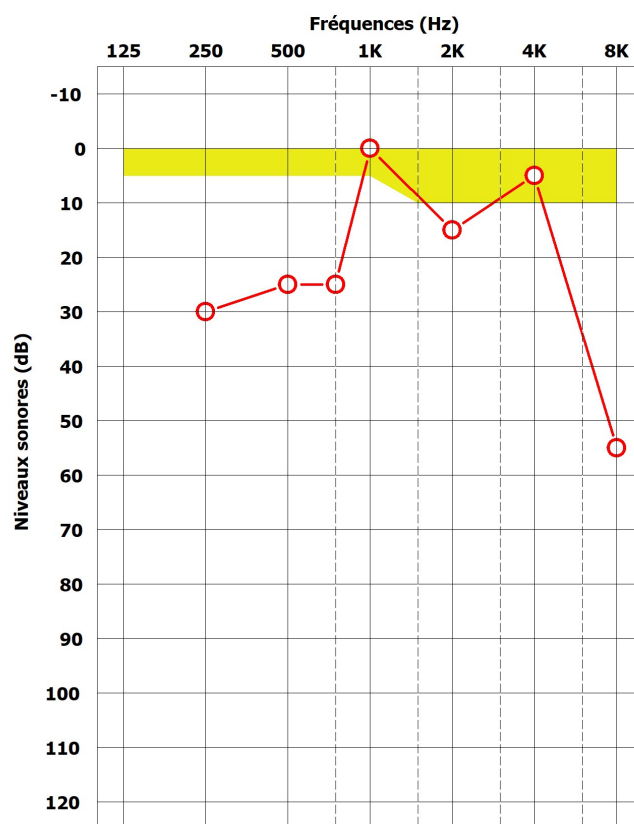

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	40	15		15		5		-10
CA Droit		30	25	25	0		15		5		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes