

MEDVIE


Date du test: 23/03/2024 15:18:50

Durée: 9mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	NONATE MORY
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	SYNA
ID	24032315170636802

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

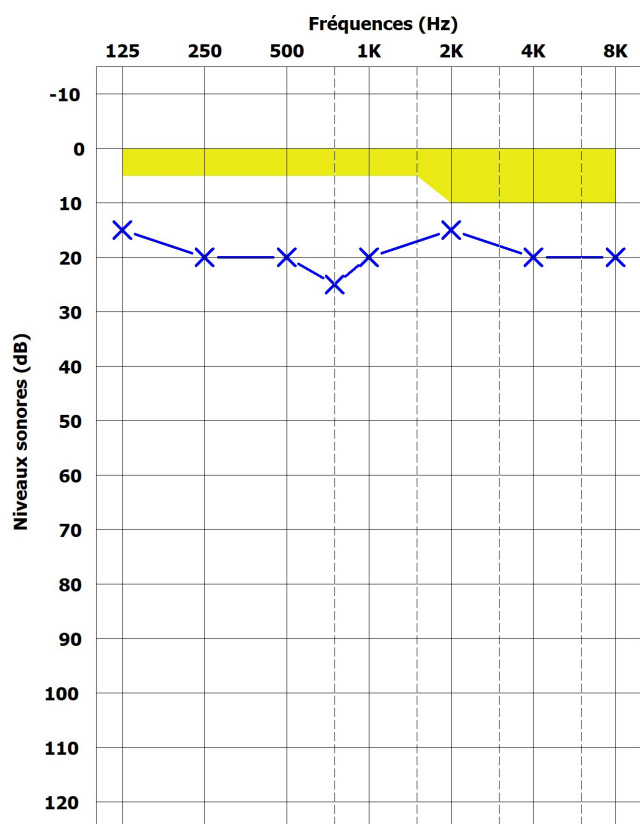

Oreille Gauche

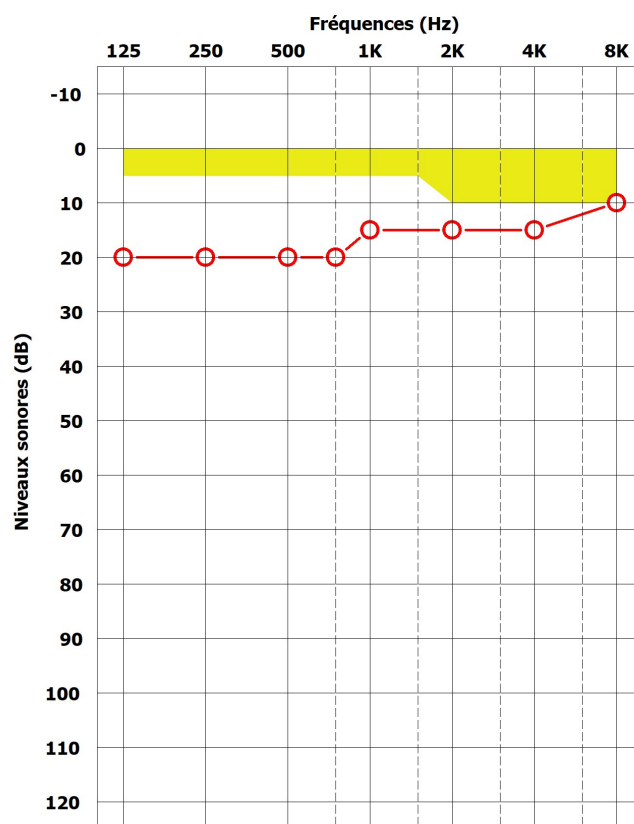

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	20	25	20		15		20		20
CA Droit	20	20	20	20	15		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes