


MEDVIE


Date du test: 10/09/2024 13:01:35
Durée: 5mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA SAIB DEEN	
Date de naissance	10/02/1983
Age	41
Société	G4S
ID	24091012494361281

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

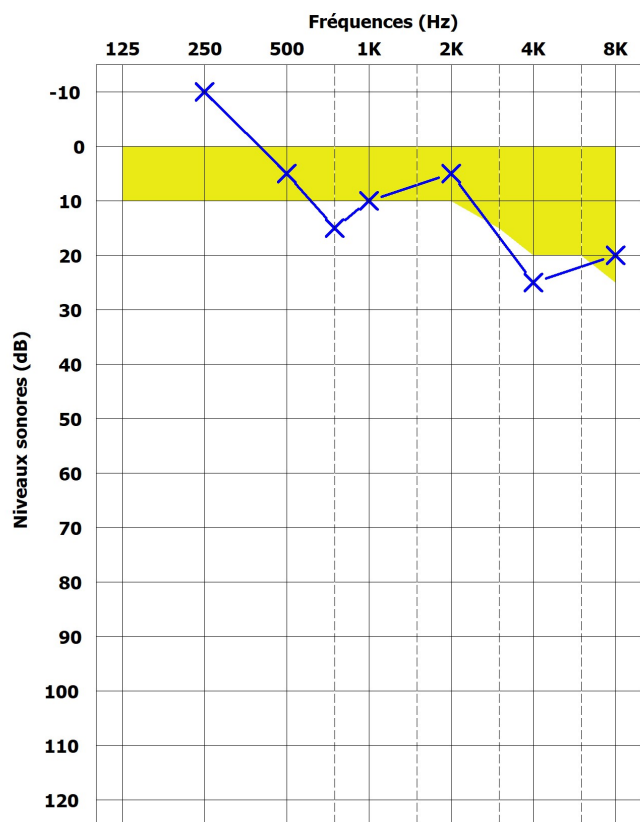

Oreille Gauche

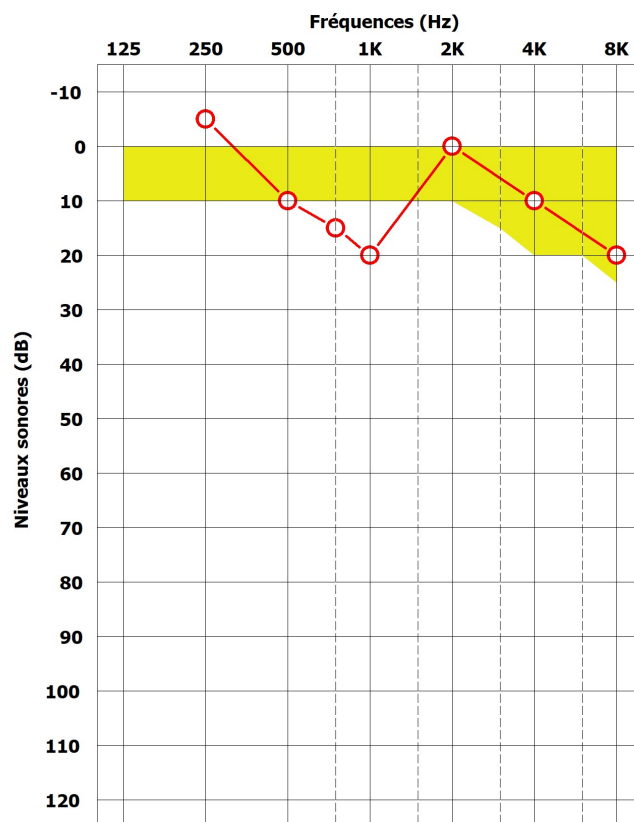

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	15	10		5		25		20
CA Droit		-5	10	15	20		0		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes