

MEDVIE

Date du test: 02/04/2024 10:41:45
Durée: 10mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

TRAORE FODE


Date de naissance: 01/01/1978
Age: 46
Société: MBEC
ID: 24040210385736035

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

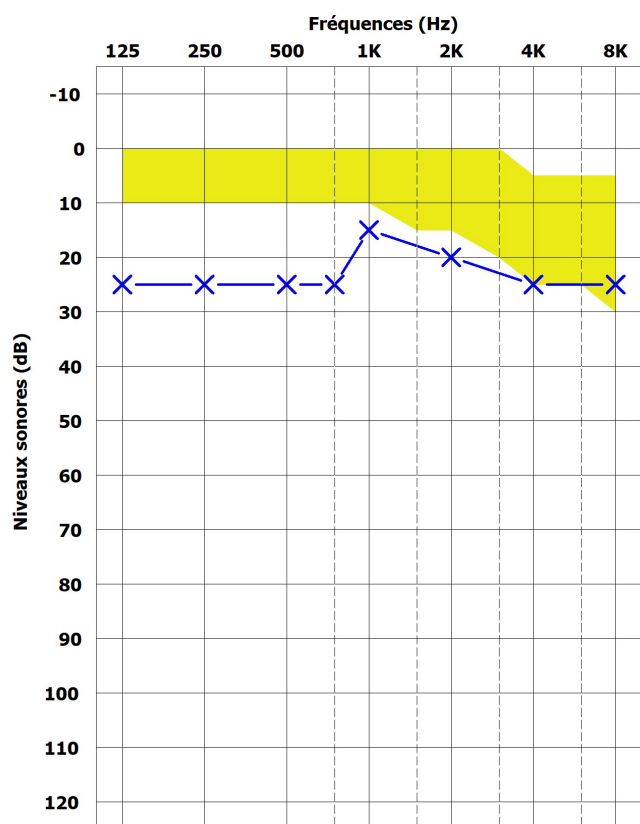

Oreille Gauche

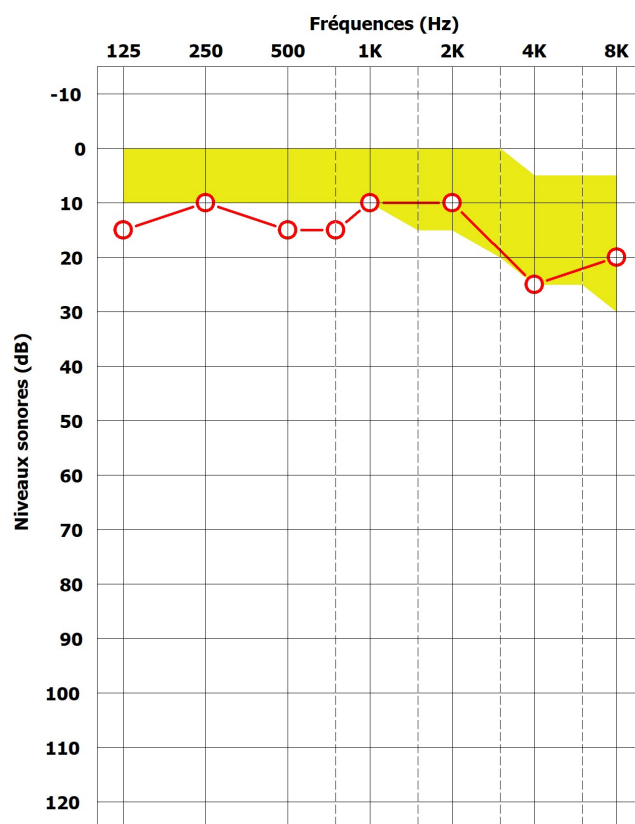

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	25	15		20		25		25
CA Droit	15	10	15	15	10		10		25		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes