


MEDVIE


Date du test: 27/09/2024 11:39:00
Durée: 3mn 45s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAVANE MOHAMED	
Date de naissance	11/01/2002
Age	22
Société	SOGEFEL
ID	24092711333440067

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

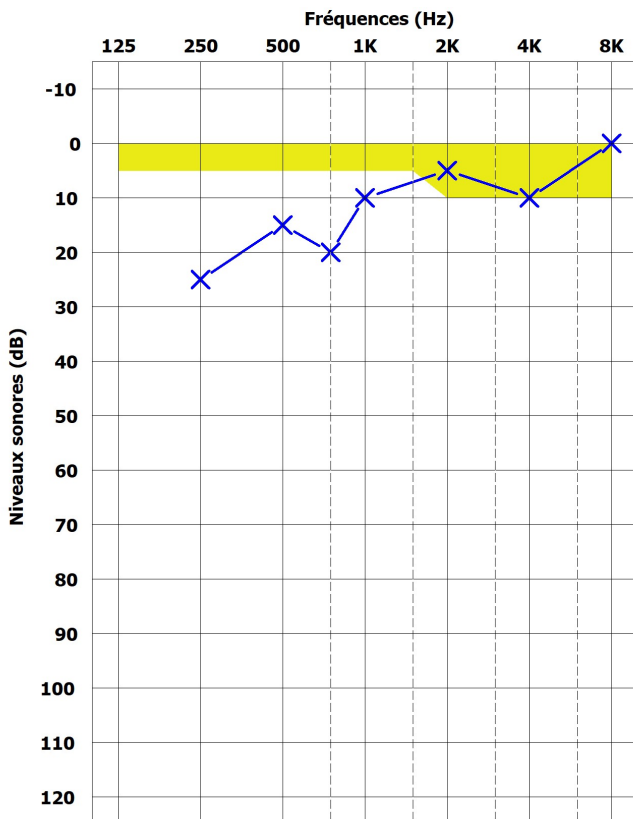

Oreille Gauche

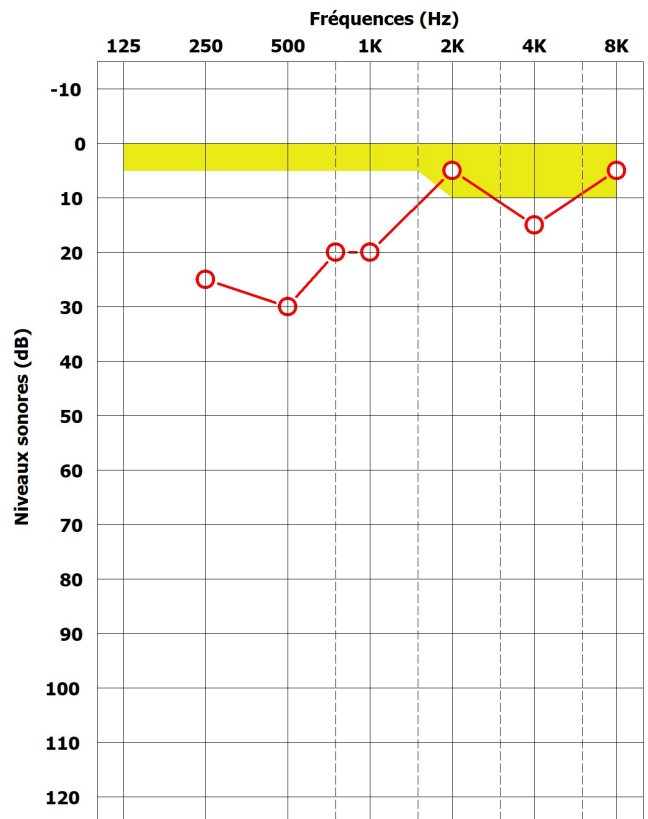

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	20	10		5		10		0
CA Droit		25	30	20	20		5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes