


MEDVIE

Date du test: 08/08/2024 12:57:07

Durée: 5mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

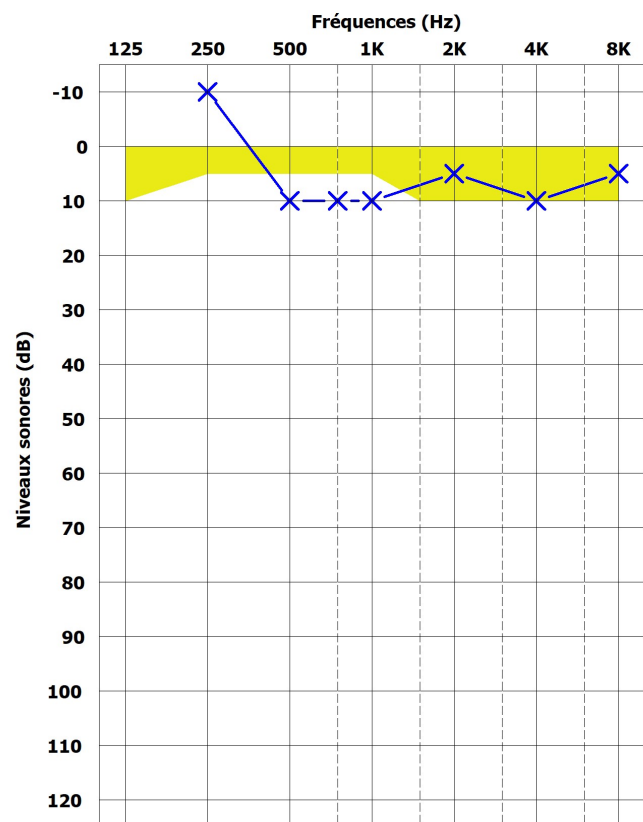

Oreille Gauche

Données Patient		DIAKITE Kabinet II
Date de naissance	11/05/1996	
Age	28	
Société	SOGEFEL	
ID	24080812544237197	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

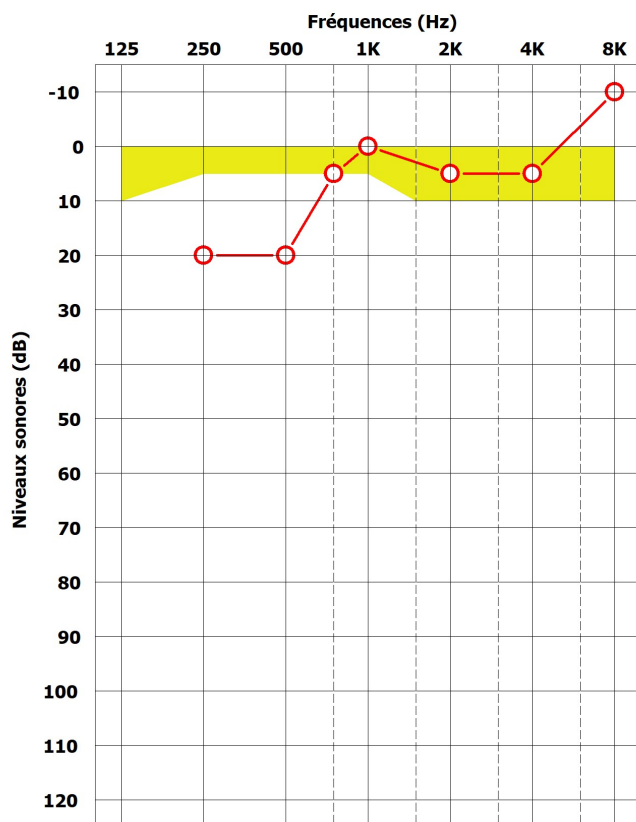

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	10	10	10		5		10		5
CA Droit		20	20	5	0		5		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes