

MEDVIE


Date du test: 30/05/2024 13:35:18

Durée: 4mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BEAVOGUI MAMADY	
Date de naissance	02/01/1992
Age	32
Société	SOGEFEL
ID	24053013331107236

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

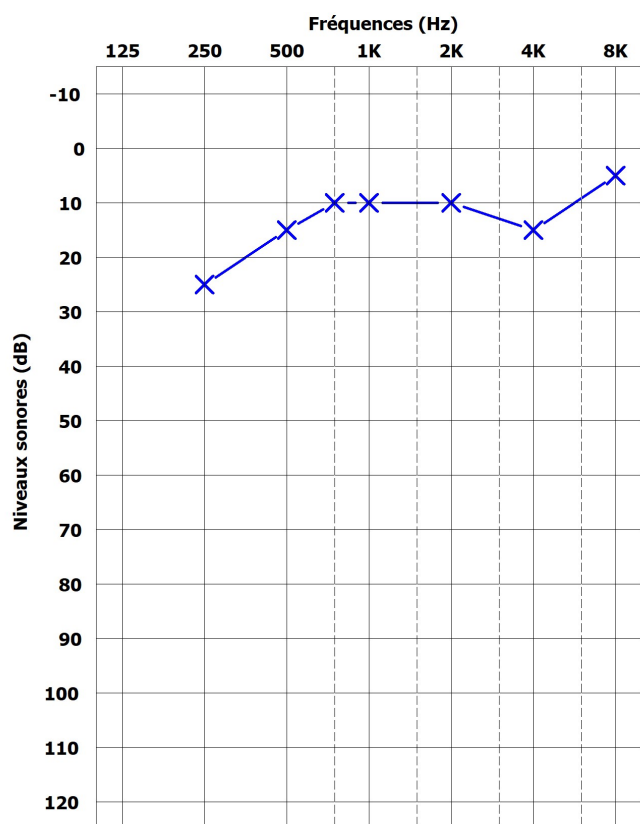

Oreille Gauche

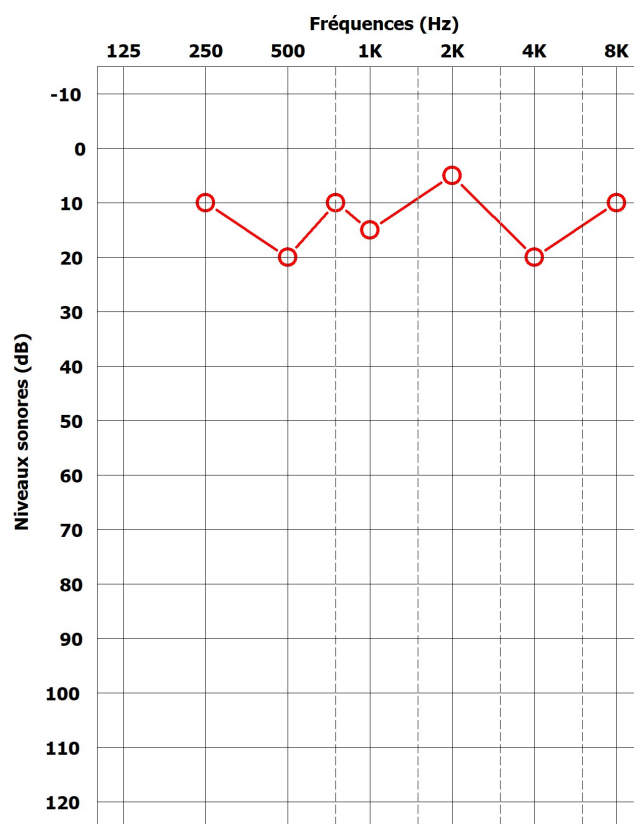

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	10	10		10		15		5
CA Droit		10	20	10	15		5		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes