


MEDVIE


Date du test: 27/05/2024 12:40:18

Durée: 5mn 44s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

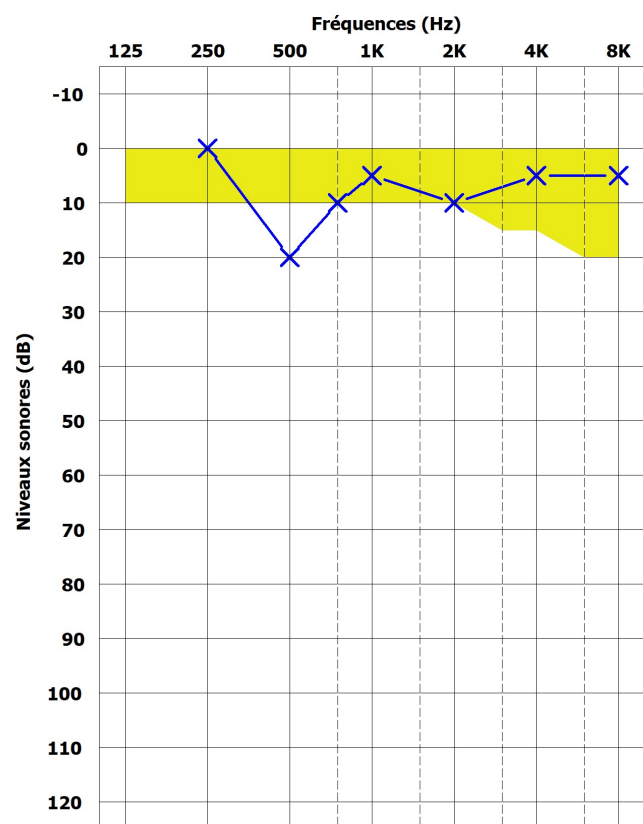

Oreille Gauche

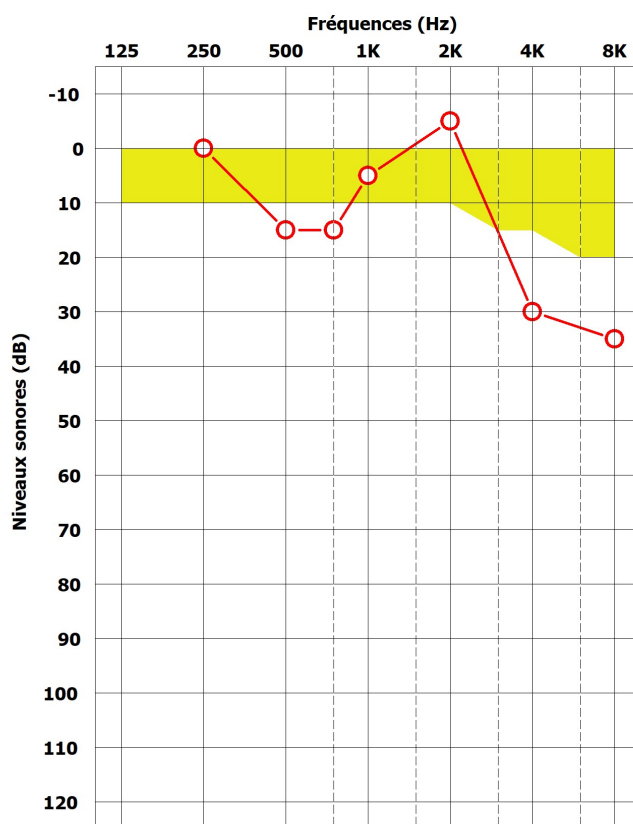

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 20  | 10  | 5  |     | 10 |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  |     | 0   | 15  | 15  | 5  |     | -5 |    | 30 |    | 35 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 10,0 dB | --- |
| CA Droit  | 11,3 dB | --- |

Notes

Données Patient

**BAMBA Dikena**

Date de naissance

03/01/1986

Age

38

Société

sogefel

ID

24052712285320574

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021