

MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 15:19:23

Durée: 5mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA Badara Aly	
Date de naissance	03/06/1996
Age	27
Société	sogefel
ID	24052015152574023

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

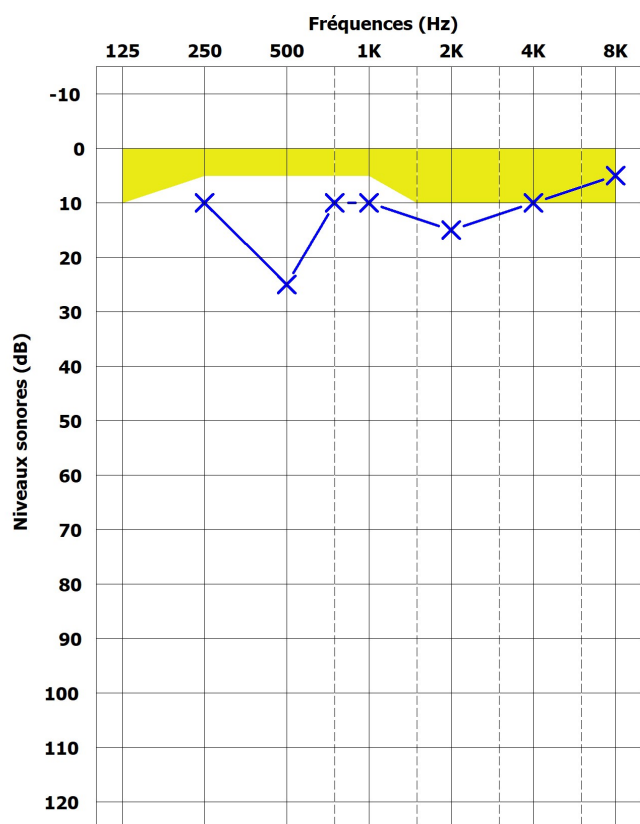

Oreille Gauche

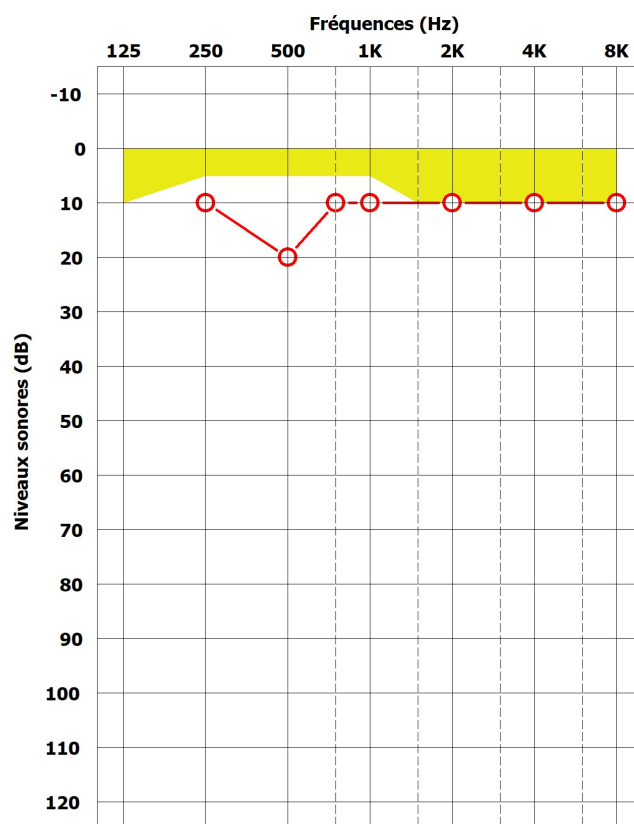

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	10	10		15		10		5
CA Droit		10	20	10	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes