

MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 13:24:57

Durée: 5mn 56s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | BAH MAMADOU BAILO |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 10/09/1982        |
| Age               | 41                |
| Société           | SOGEFEL           |
| ID                | 24051013035537496 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

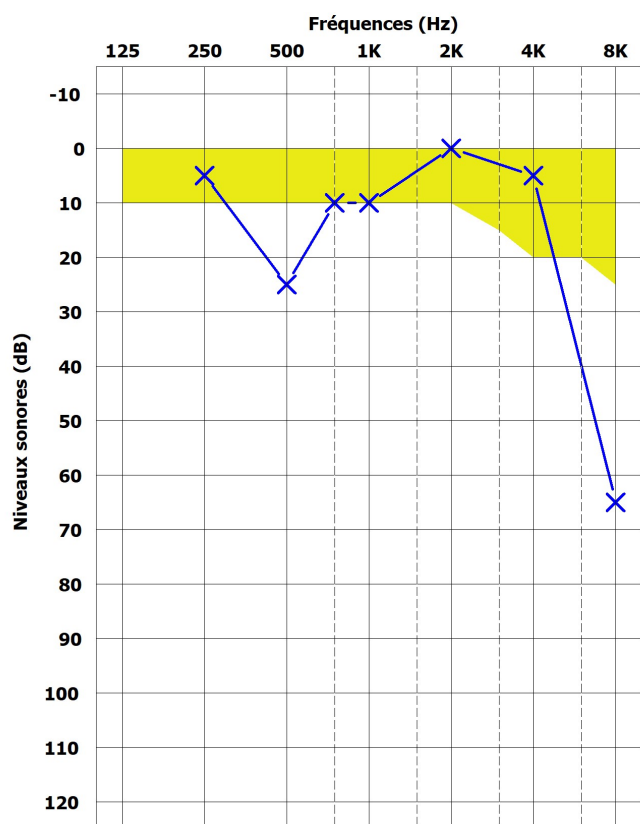

Oreille Gauche

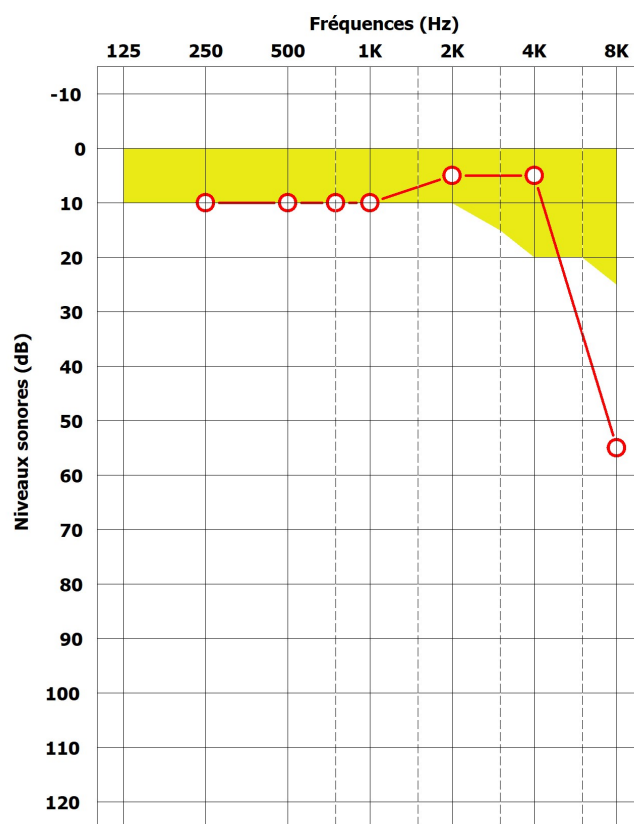

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 25  | 10  | 10 |     | 0  |    | 5  |    | 65 |
| CA Droit  |     | 10  | 10  | 10  | 10 |     | 5  |    | 5  |    | 55 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 10,0 dB | --- |
| CA Droit        | 7,5 dB  | --- |

Notes