


MEDVIE


Date du test: 28/05/2024 13:40:39
Durée: 9mn 11s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		FARO FACELY
Date de naissance	02/02/1971	
Age	53	
Société	SOGEFEL	
ID	24052813384211390	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

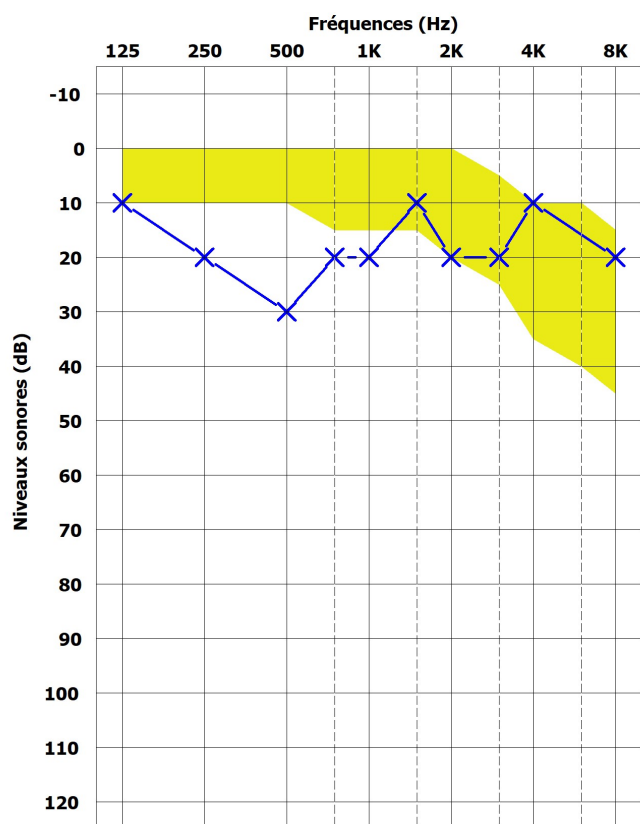

Oreille Gauche

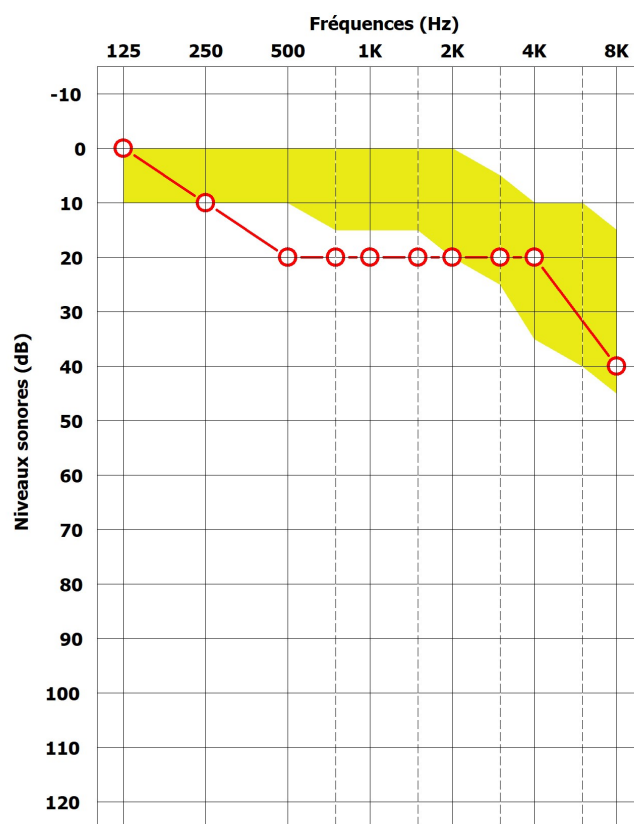

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	20	30	20	20	10	20	20	10		20
CA Droit	0	10	20	20	20	20	20	20	20		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes