

MEDVIE

Date du test: 10/05/2024 13:07:43

Durée: 5mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **BAH MAMADOU BAILO**

Date de naissance 10/09/1982

Age 41

Société SOGEFEL


ID 24051013035537496

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

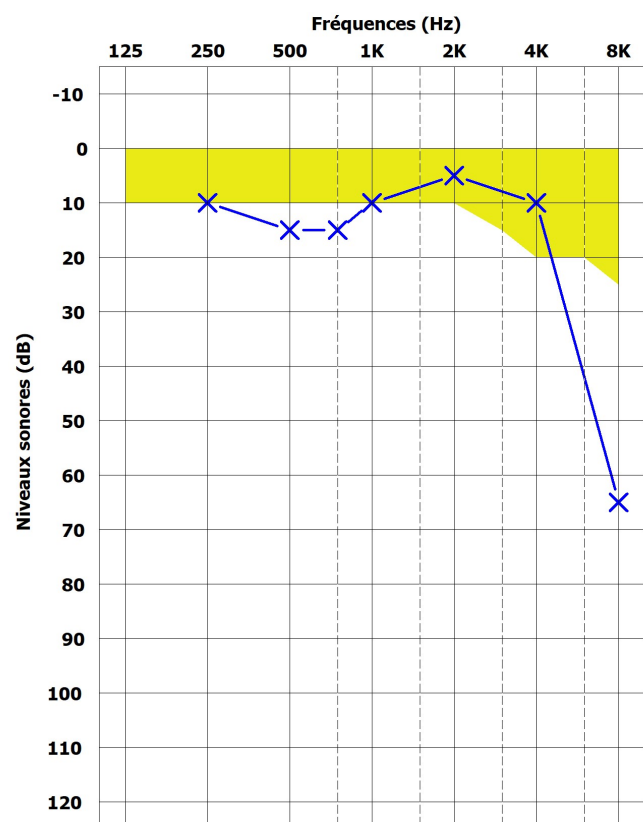

Oreille Gauche

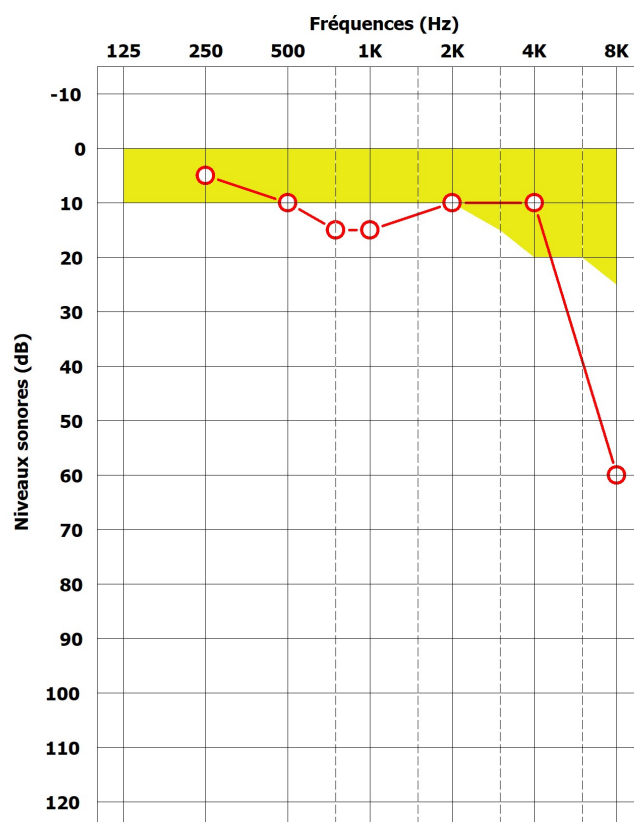

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	10		5		10		65
CA Droit		5	10	15	15		10		10		60

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes