

MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 12:59:38

Durée: 5mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		HABA NESTOR
Date de naissance	05/03/1999	
Age	25	
Société	SOGEFEL	
ID	24100312462975486	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

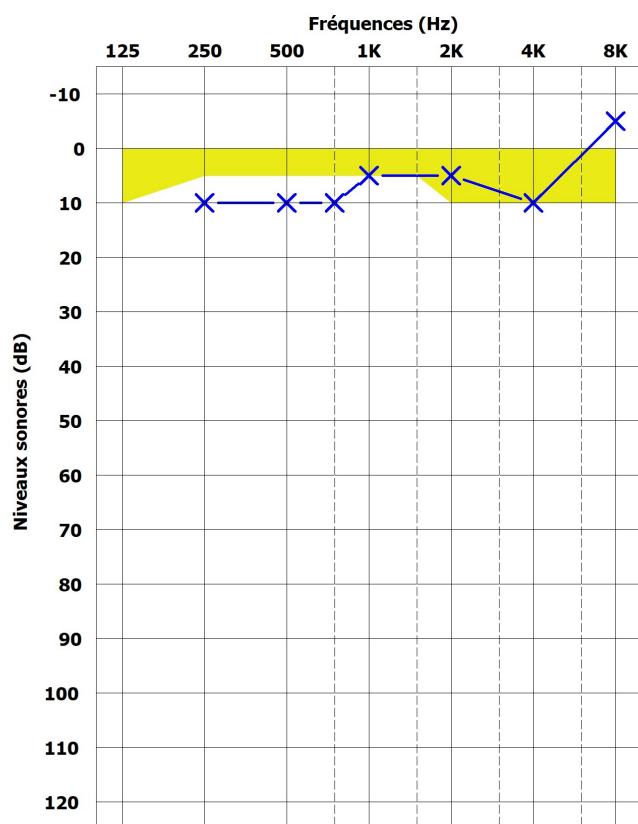

Oreille Gauche

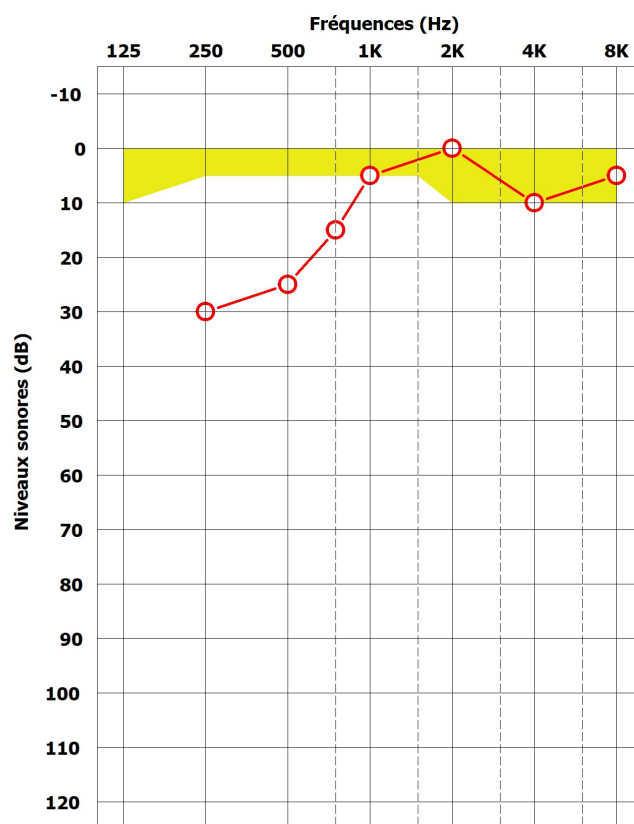

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	5		5		10		-5
CA Droit		30	25	15	5		0		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes