


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 15:38:22
Durée: 3mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DAYANGHIRANG DONALD	
Date de naissance	08/07/1975
Age	48
Société	SOGEFEL
ID	24052015284383656

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

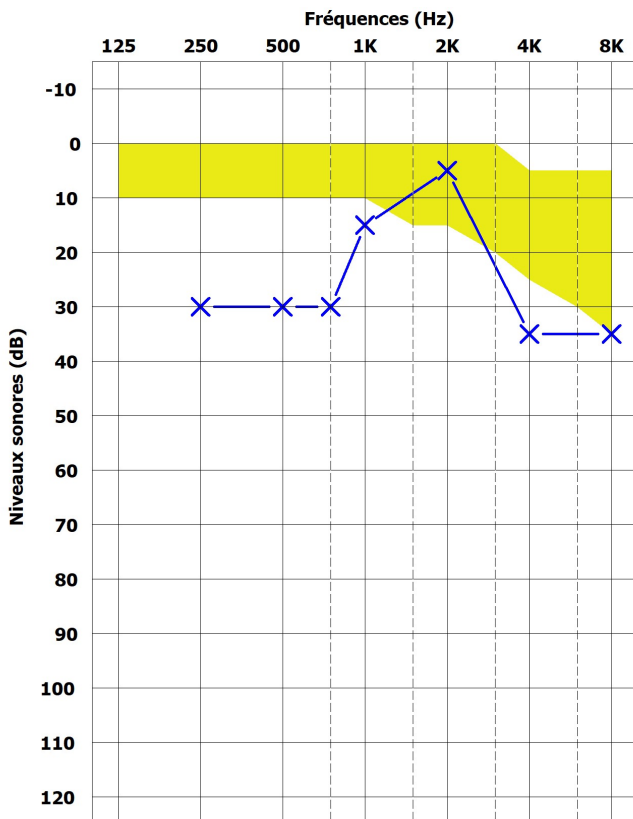

Oreille Gauche

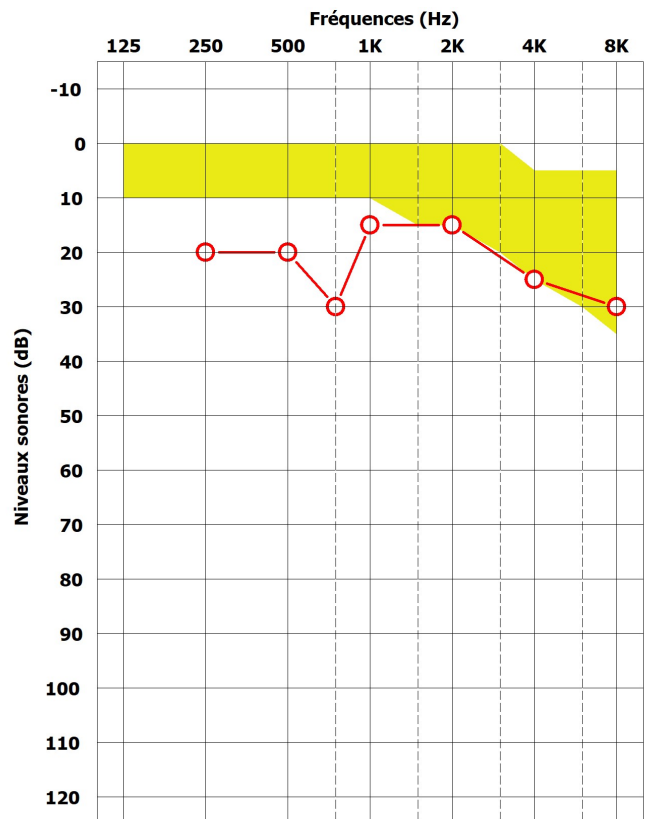

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	30	15		5		35		35
CA Droit		20	20	30	15		15		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes