

MEDVIE


Date du test: 16/05/2024 13:02:22

Durée: 5mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO MAMADOU	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	SOGEFEL
ID	24051612515542548

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

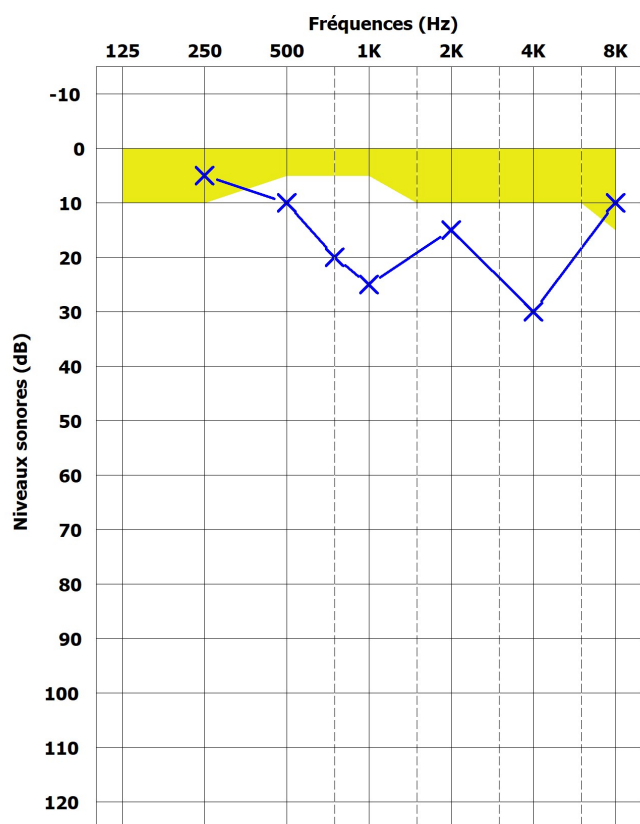

Oreille Gauche

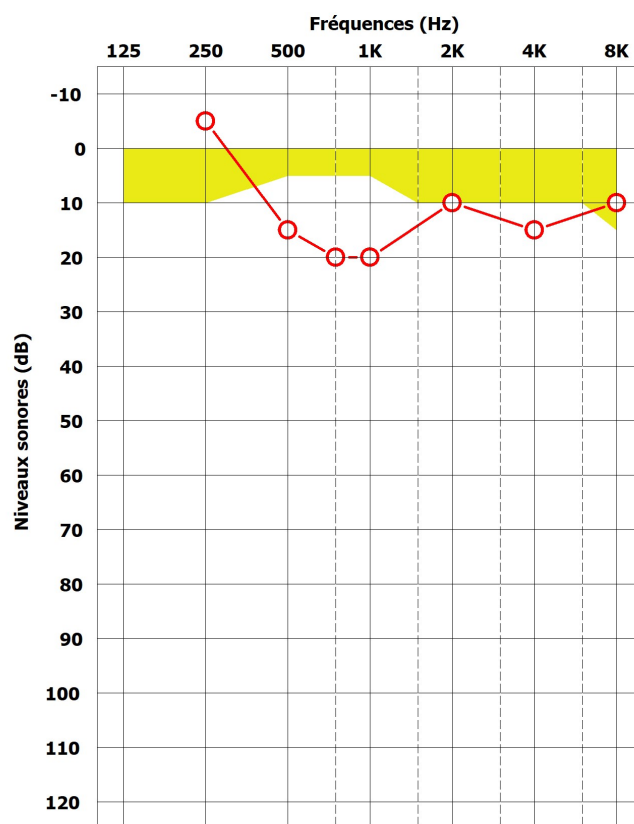

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	20	25		15		30		10
CA Droit		-5	15	20	20		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes