


Données Patient		TRAORE ANSOUMANE
Date de naissance	05/03/1996	
Age	28	
Société	SOGEFEL	
ID	24090212232908624	


MEDVIE

Date du test: 02/09/2024 12:25:36  
 Durée: 5mn 33s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

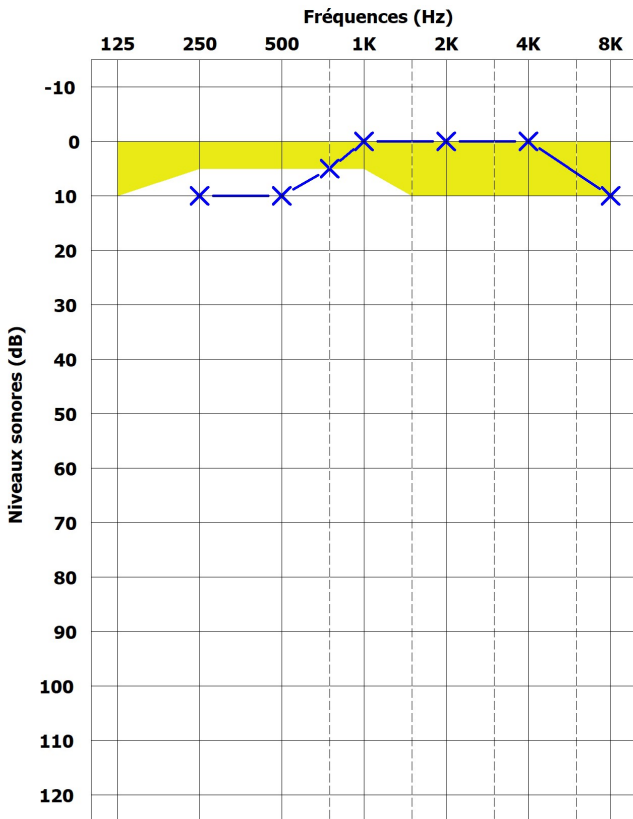

Oreille Gauche

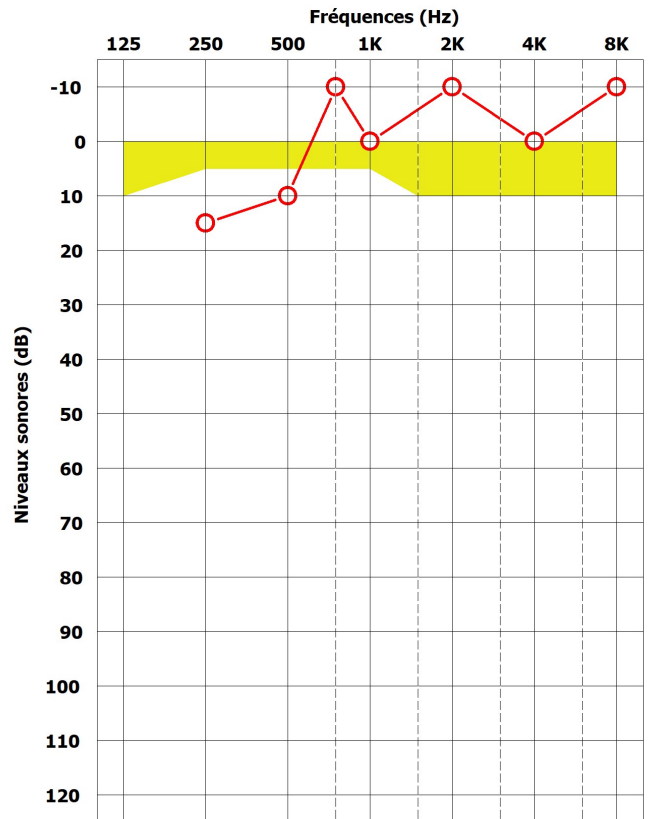

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	0		0		0		10
CA Droit		15	10	-10	0		-10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	2,5 dB
CA Droit	0,0 dB	---

Notes