


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 13:43:19
Durée: 8mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DABO MOHAMED
Date de naissance	07/07/1995
Age	28
Société	SOGEFEL
ID	24051513410211923

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

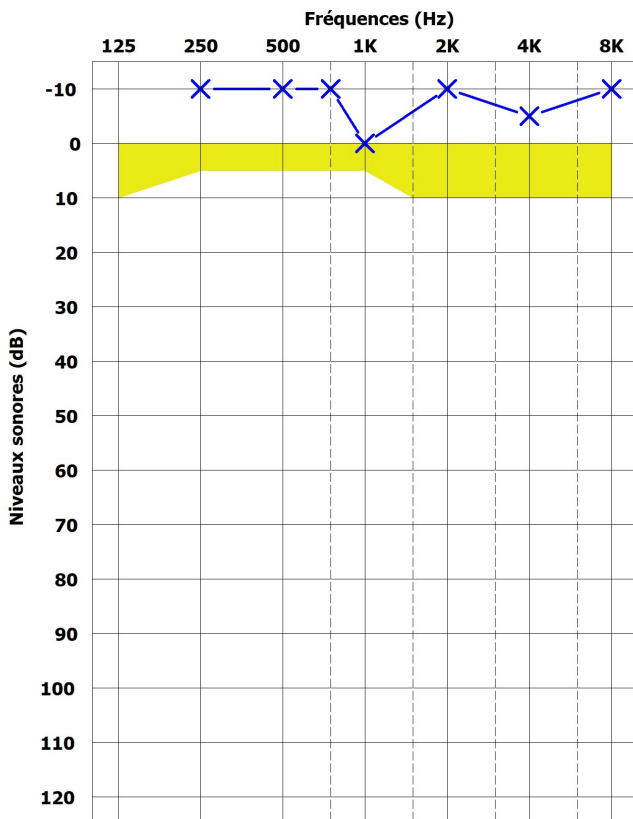

Oreille Gauche

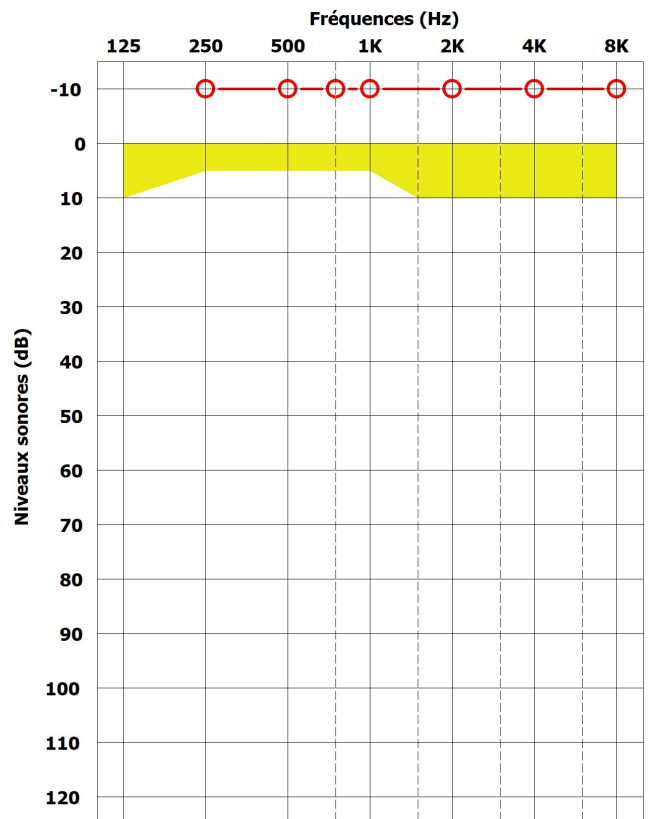

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-10	0		-10		-5		-10
CA Droit		-10	-10	-10	-10		-10		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-6,3 dB	---
CA Droit	-10,0 dB	---

Notes