

MEDVIE

Date du test: 17/09/2024 13:03:22


Durée: 4mn 09s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient		KAKE SEKOU
Date de naissance	28/11/1965	
Age	58	
Société	SOGEFEL	
ID	24091712560104642	

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

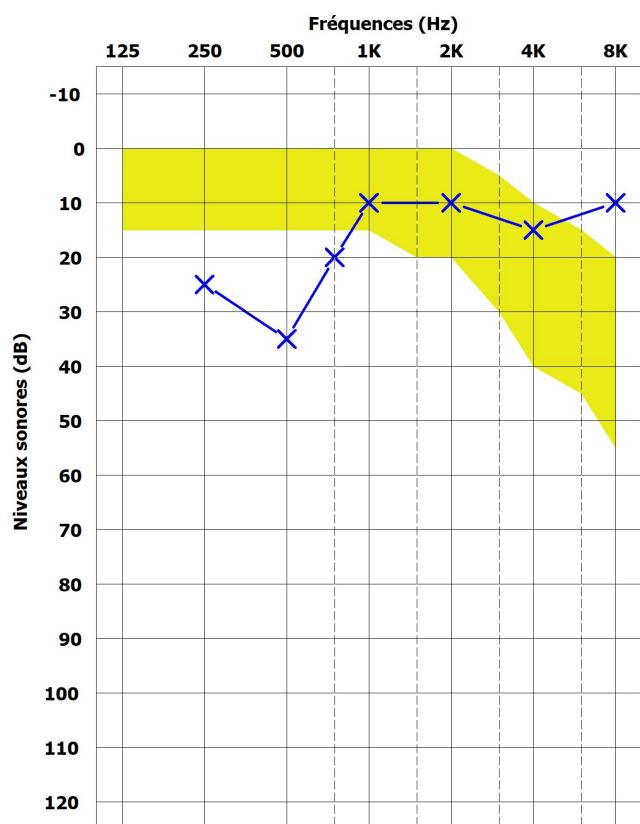

Oreille Gauche

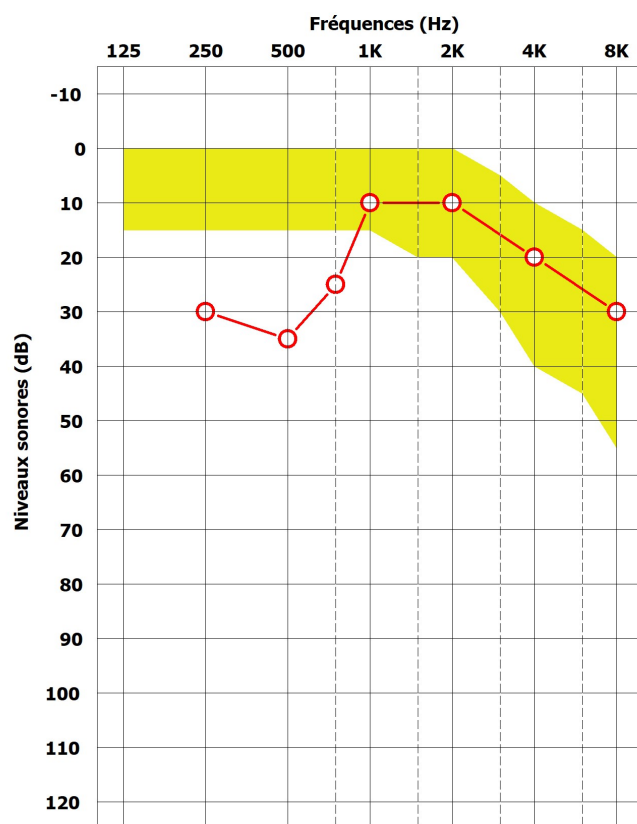

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	20	10		10		15		10
CA Droit		30	35	25	10		10		20		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes