


MEDVIE


Date du test: 05/09/2024 11:42:36
Durée: 3mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAVANE MOHAMED	
Date de naissance	01/07/1992
Age	32
Société	SOGEFEL
ID	24090510541209020

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

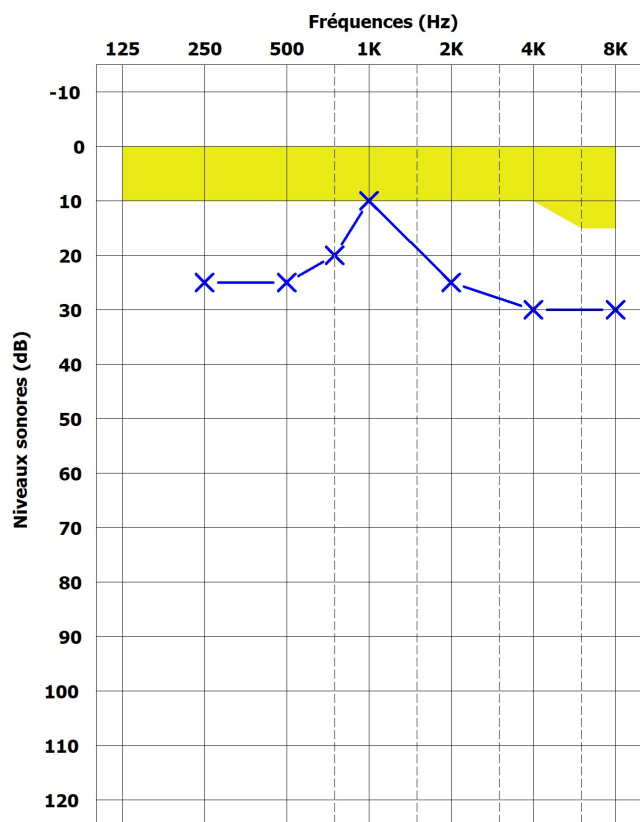

Oreille Gauche

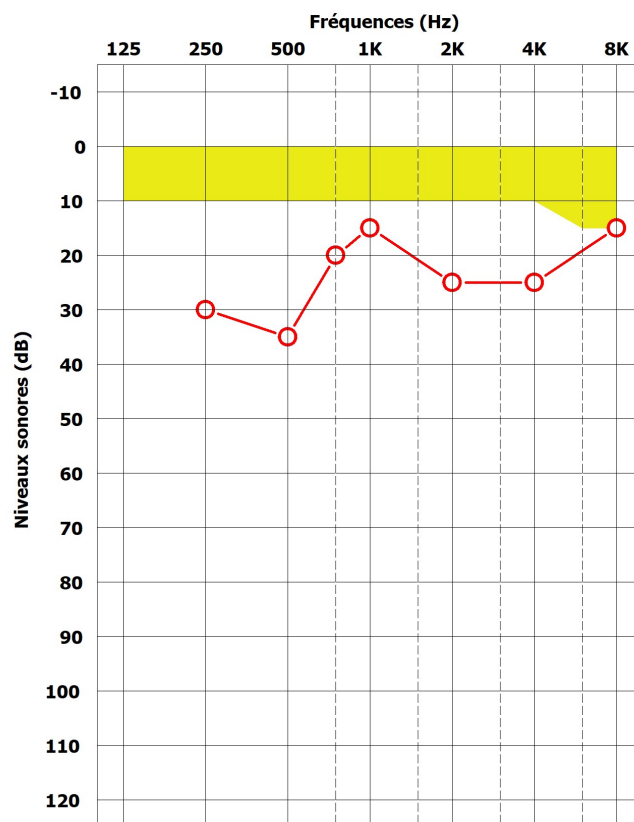

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	10		25		30		30
CA Droit		30	35	20	15		25		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes