

MEDVIE


Date du test: 05/08/2024 12:57:01

Durée: 5mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SYLLA FODE MOMO
Date de naissance	25/11/1990	
Age	33	
Société	SOGEFEL	
ID	24080512541373719	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

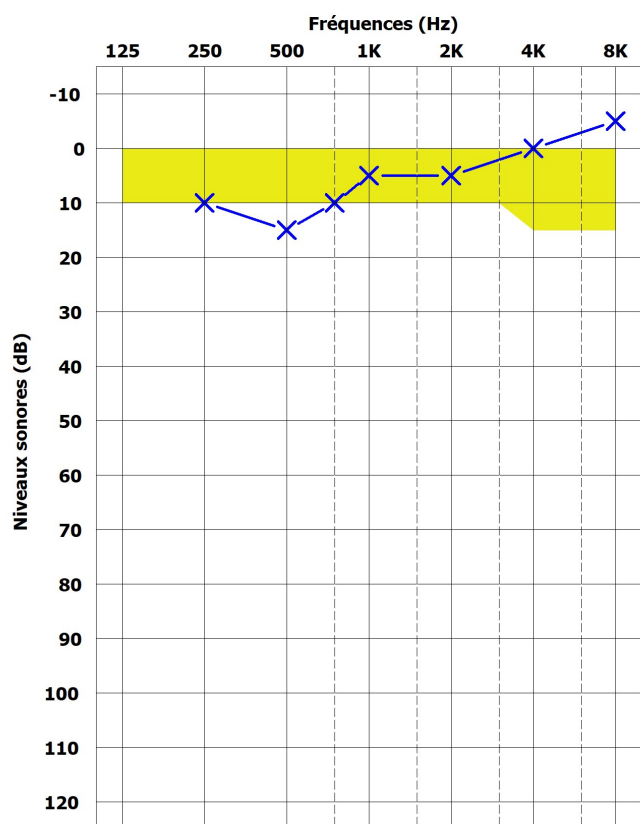

Oreille Gauche

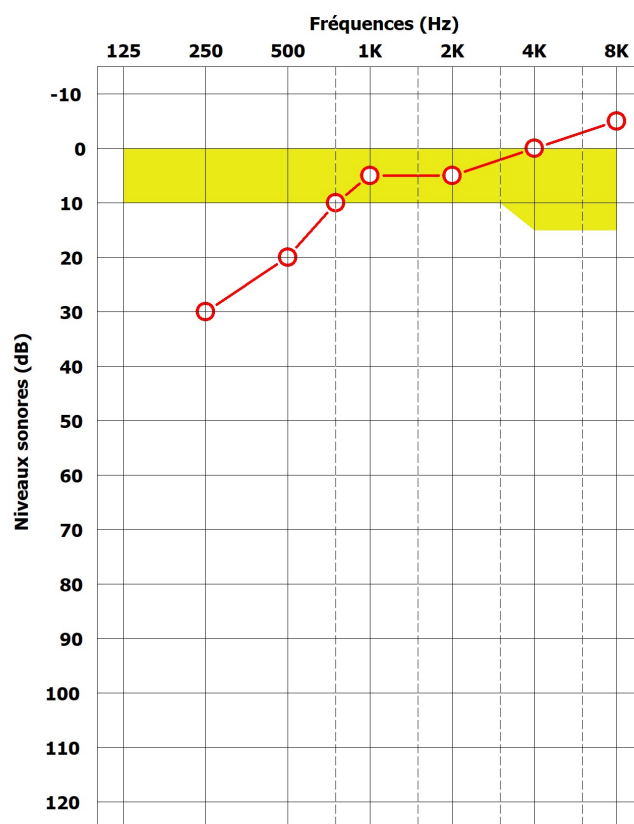

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	5		5		0		-5
CA Droit		30	20	10	5		5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes