


MEDVIE


Date du test: 21/06/2024 12:13:07
Durée: 3mn 37s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO AMADOU I AMARANA
Date de naissance	03/02/1995	
Age	29	
Société	CAWA	
ID	24062112100425135	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

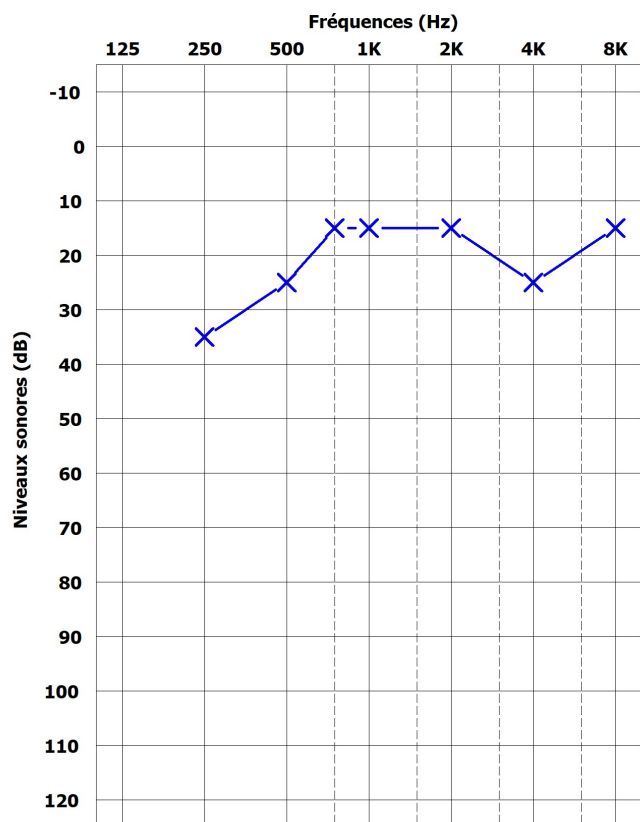

Oreille Gauche

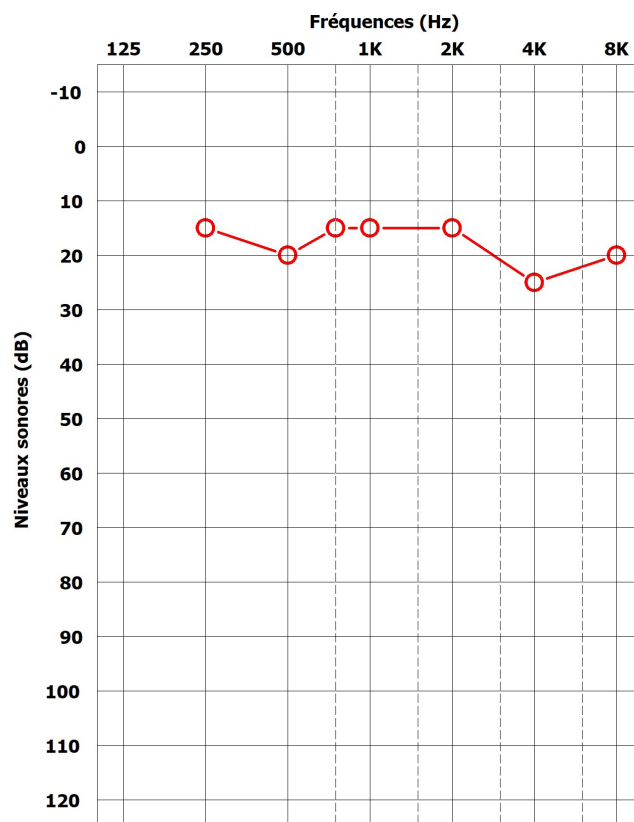

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	15	15		15		25		15
CA Droit		15	20	15	15		15		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes