

MEDVIE


Date du test: 15/05/2025 10:17:51

Durée: 5mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA Alpha oumar	
Date de naissance	04/04/1984
Age	41
Société	TRUST AFRICA
ID	25051510153878197

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

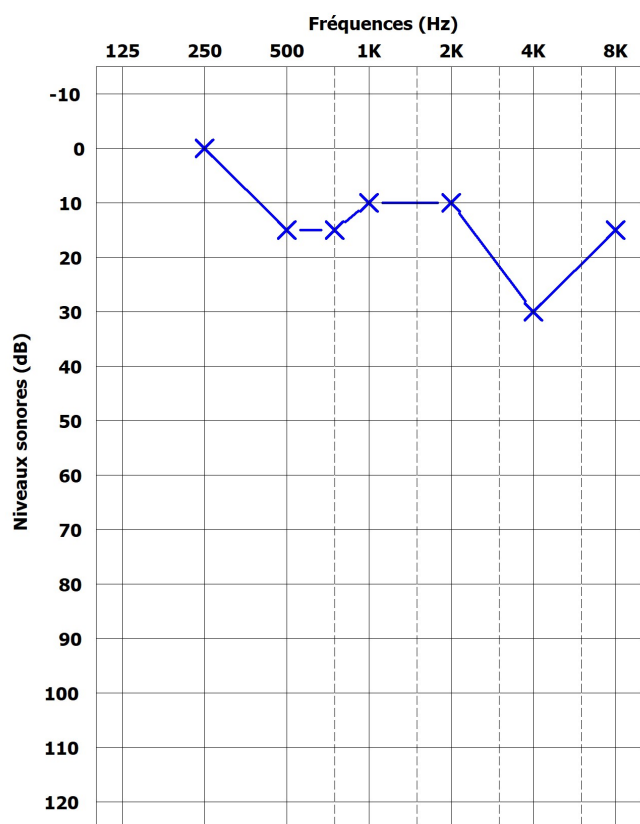

Oreille Gauche

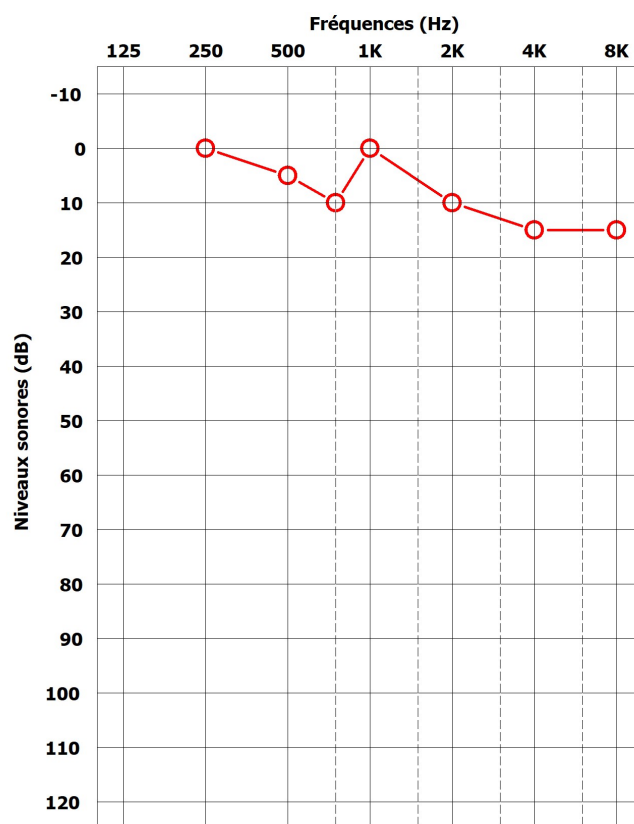

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	15	10		10		30		15
CA Droit		0	5	10	0		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes