



Données Patient	CAMARA NAMORY
Date de naissance	29/12/1985
Age	38
Société	BEDROS
ID	24103009464093496

Date du test: 30/10/2024 09:48:55
 Durée: 5mn 47s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

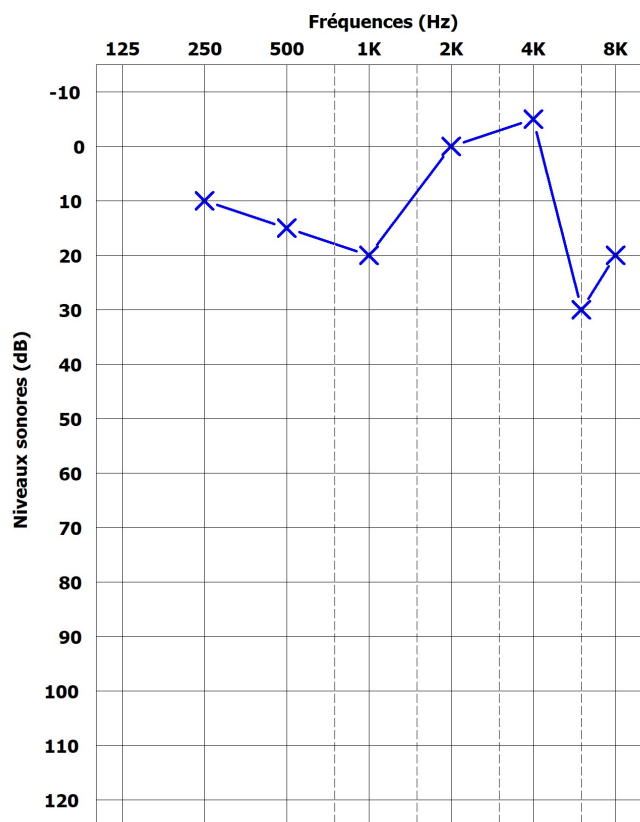

Oreille Gauche

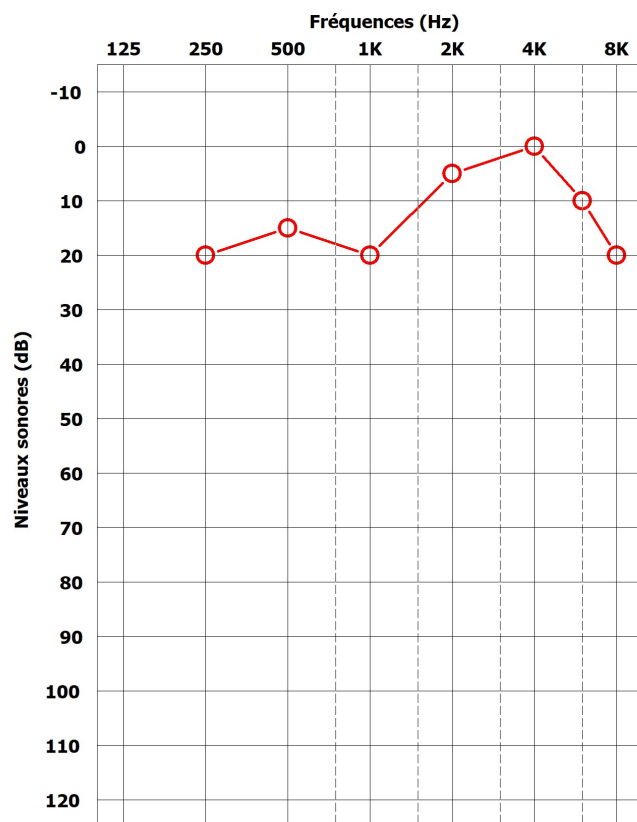

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15		20		0		-5	30	20
CA Droit		20	15		20		5		0	10	20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes