


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 17:32:23
Durée: 3mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAGNO ANDRE	
Date de naissance	01/01/1977
Age	47
Société	CHEC
ID	24071717301631207

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

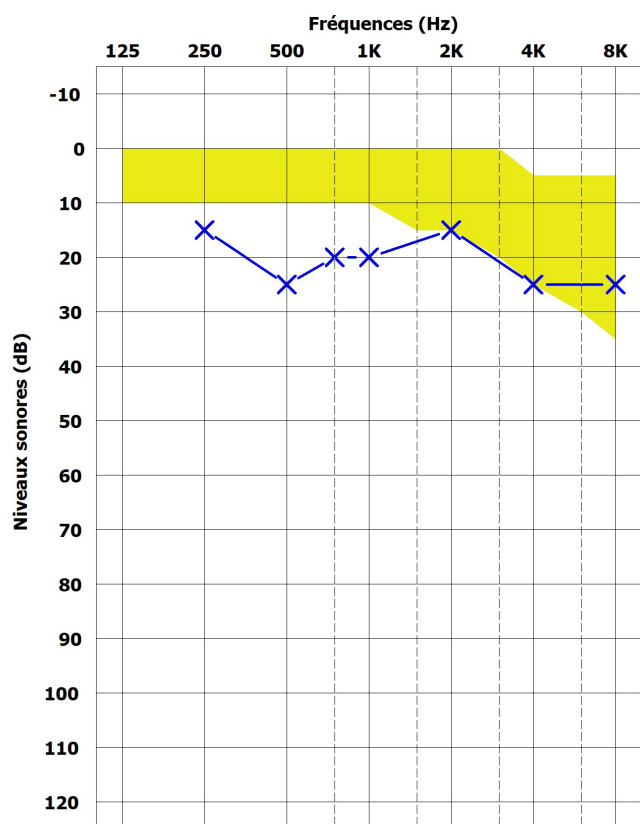

Oreille Gauche

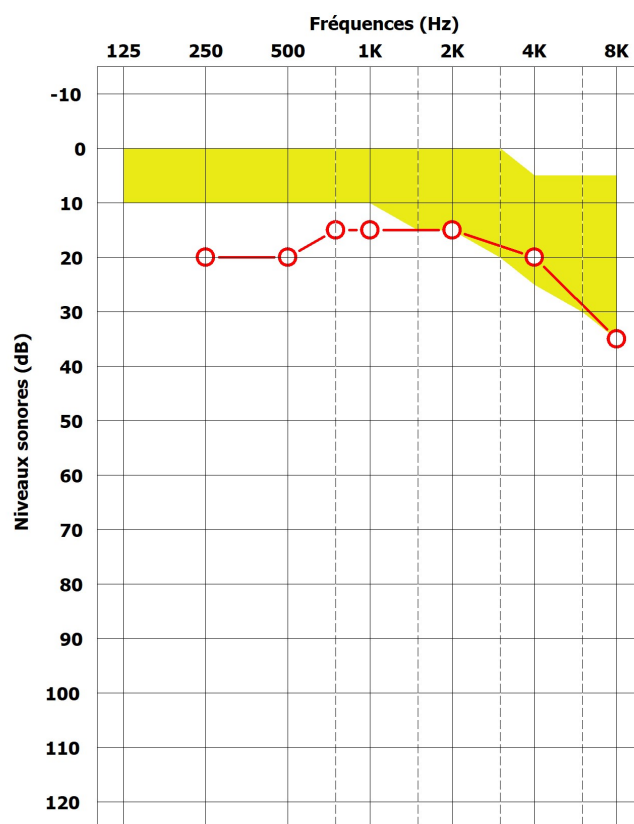

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	20		15		25		25
CA Droit		20	20	15	15		15		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes