


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 13:55:50
Durée: 3mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SOUMAH FOGÉ
Date de naissance	01/11/1980	
Age	43	
Société	CHEC	
ID	24091413541156821	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

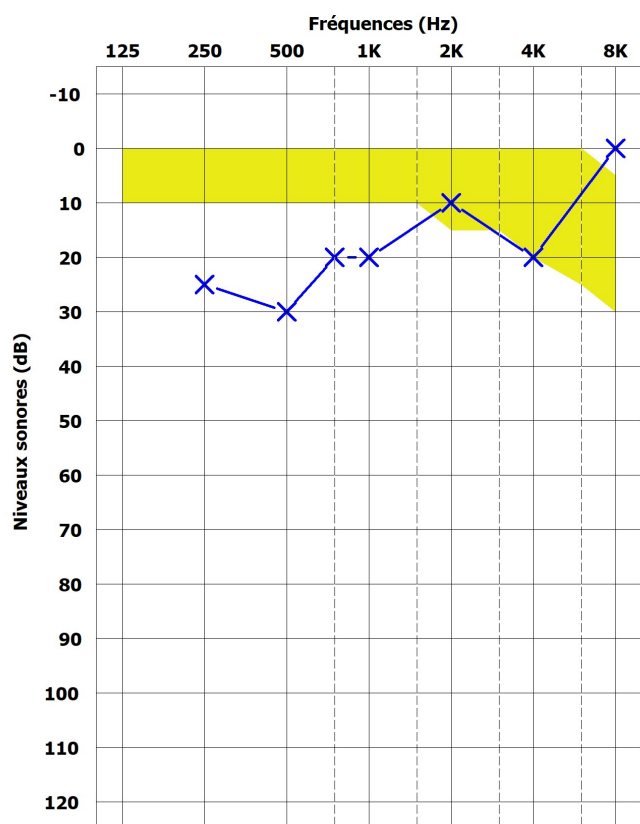

Oreille Gauche

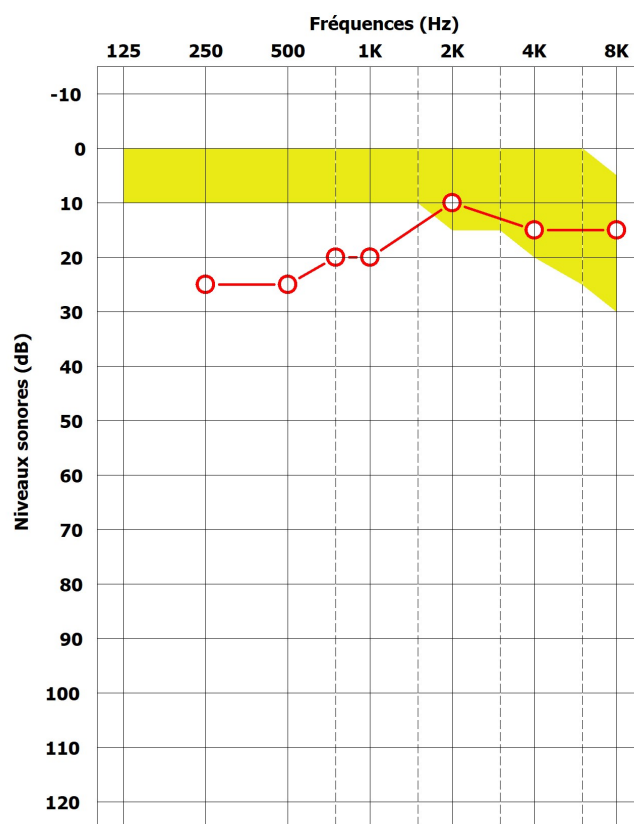

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	20		10		20		0
CA Droit		25	25	20	20		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes