


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 15:07:30
Durée: 1mn 56s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAH SALIF	
Date de naissance	09/09/2002
Age	21
Société	CHEC
ID	24081414241299986

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

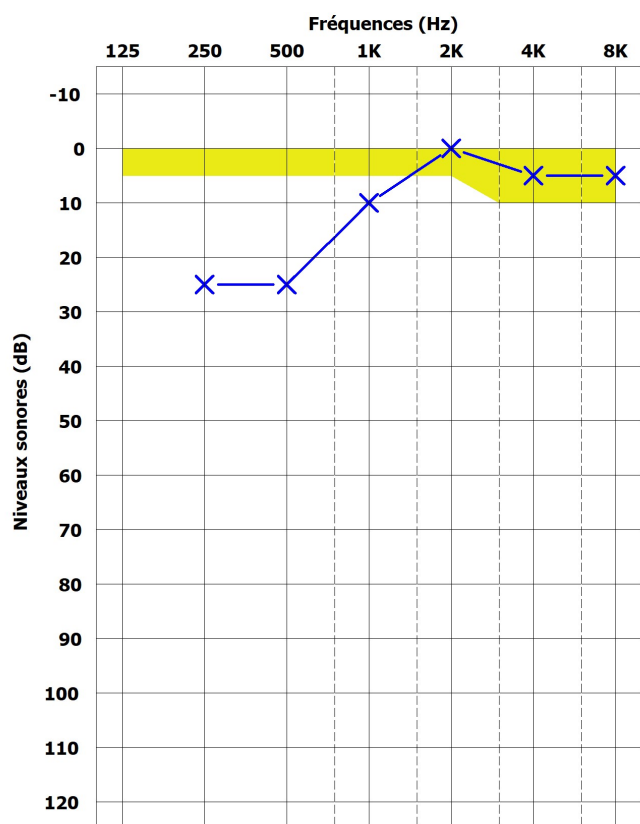

Oreille Gauche

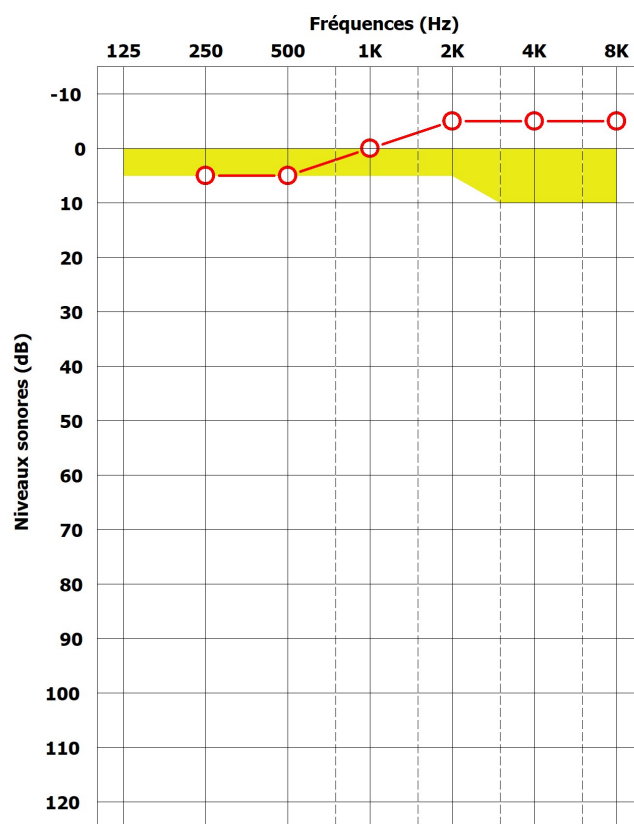

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		10		0		5		5
CA Droit		5	5		0		-5		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes