


MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 11:53:18
Durée: 3mn 05s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CAMARA FODE MOUICAR
Date de naissance	03/06/2000	
Age	24	
Société	CHEC	
ID	24071511515387694	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

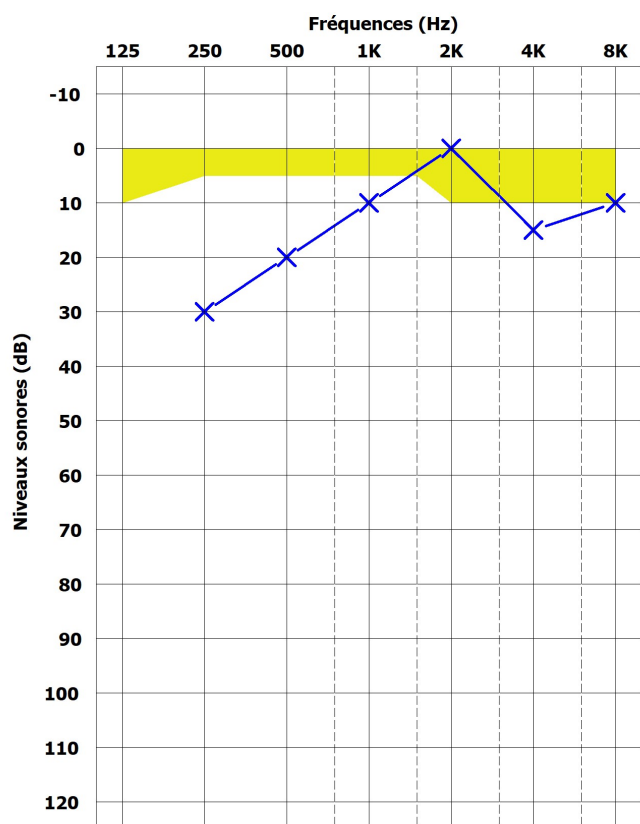

Oreille Gauche

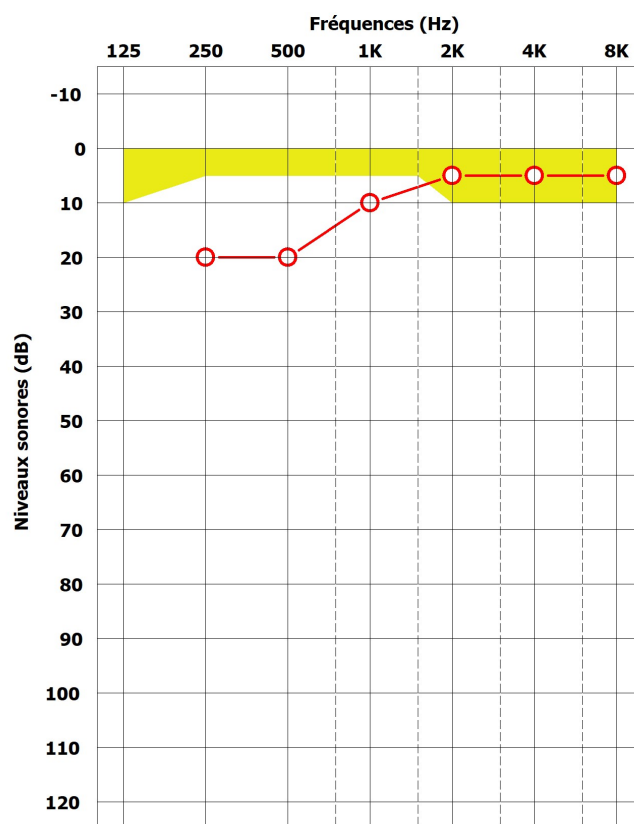

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20		10		0		15		10
CA Droit		20	20		10		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes