


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:56:53
Durée: 3mn 43s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
CAMARA SAYON	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24081412444700385

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

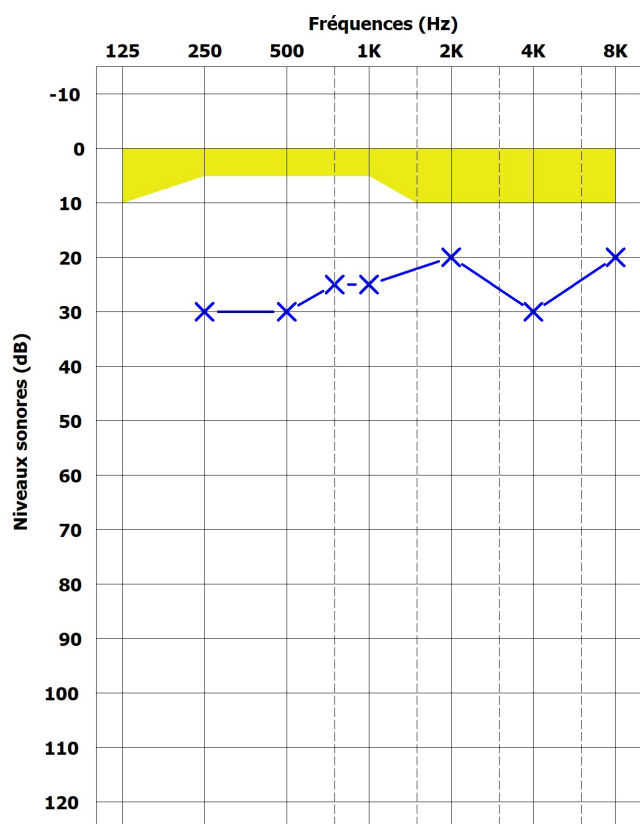

Oreille Gauche

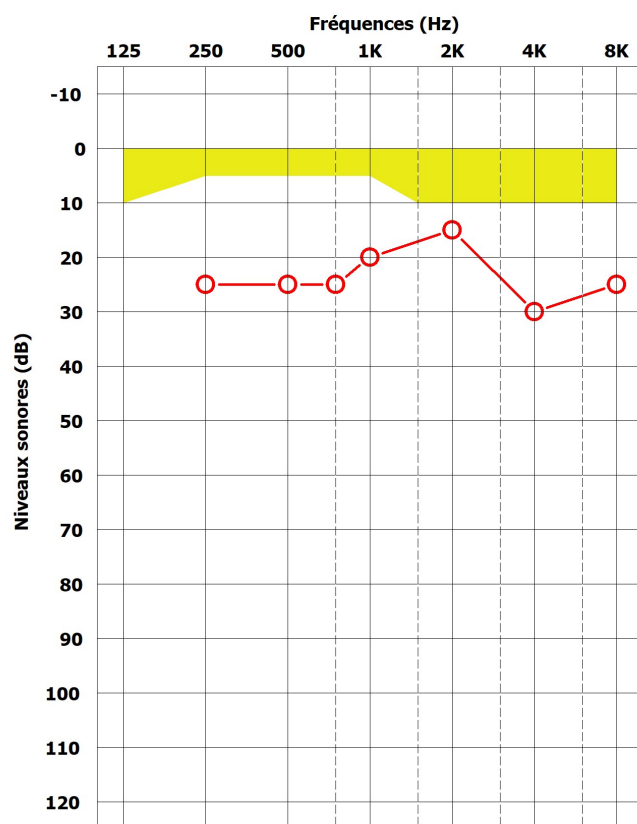

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		20		30		20
CA Droit		25	25	25	20		15		30		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes