


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 15:40:08
Durée: 2mn 55s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
MARA FODE	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24081415203272983

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

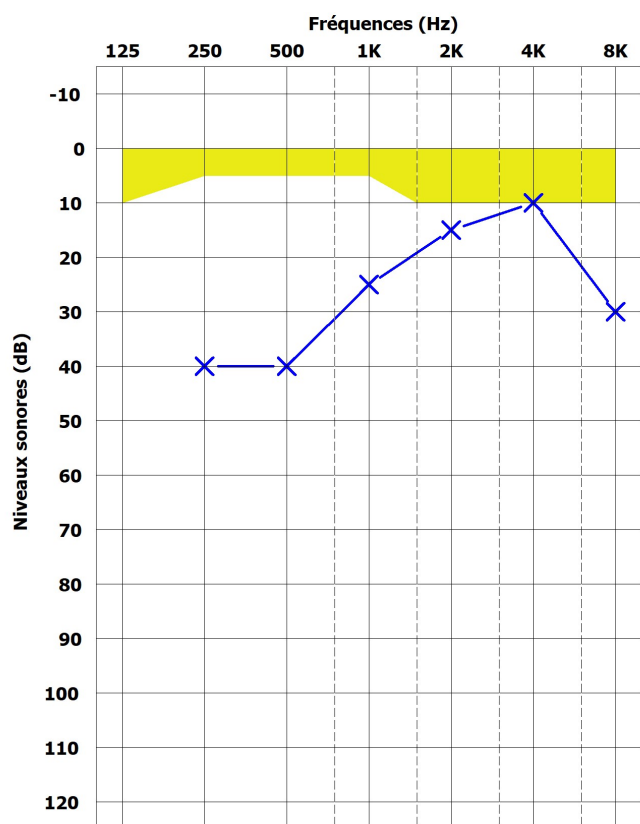

Oreille Gauche

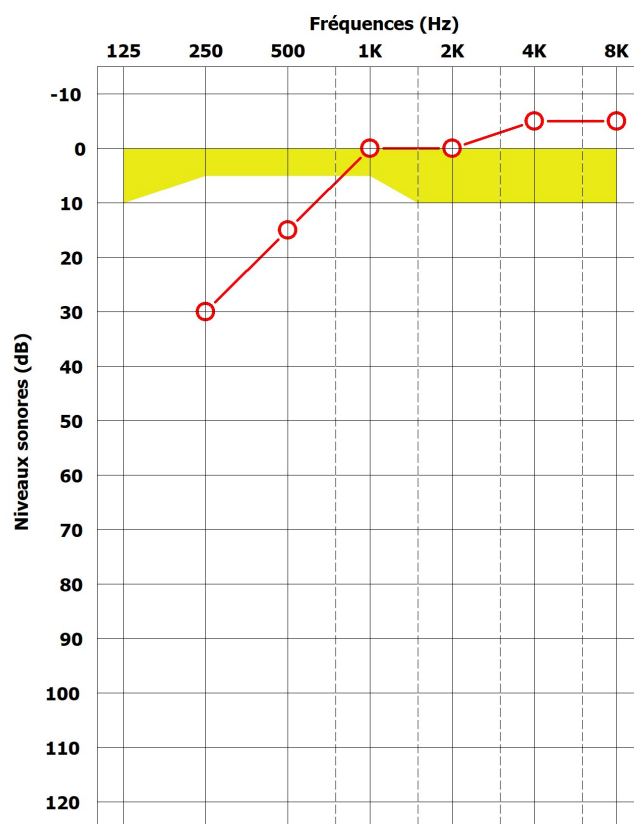

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	40		25		15		10		30
CA Droit		30	15		0		0		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes