


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 10:49:24
Durée: 4mn 42s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA MORLAYE	
Date de naissance	10/07/1972
Age	52
Société	CHEC
ID	24091410451283352

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

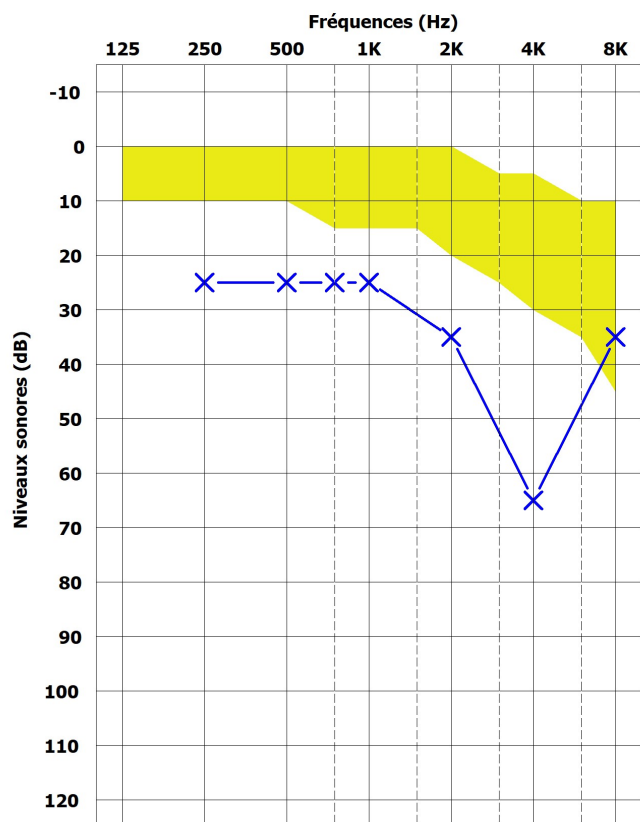

Oreille Gauche

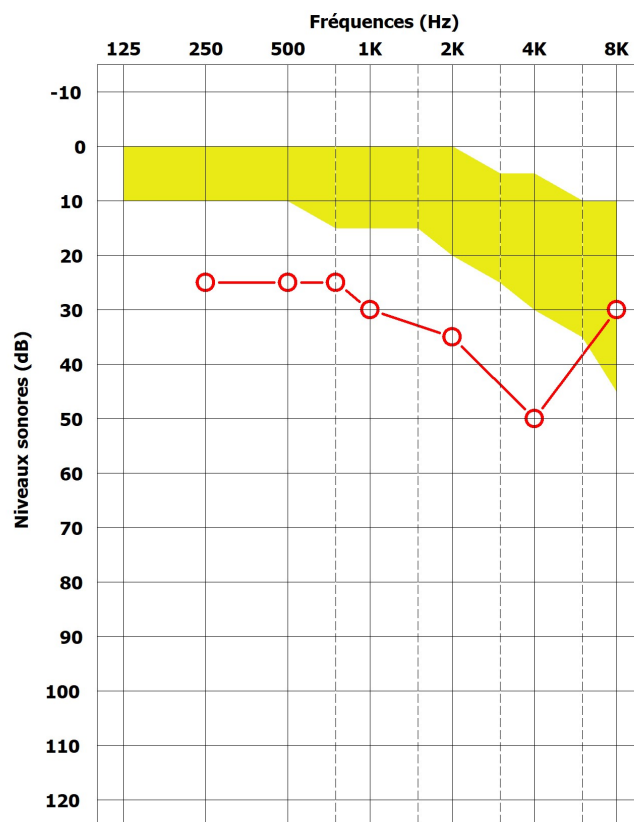

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	25		35		65		35
CA Droit		25	25	25	30		35		50		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	37,5 dB	---
CA Droit	35,0 dB	---

Notes