


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:36:45
Durée: 4mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA MOHAMED I AMINE	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24081412281652995

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

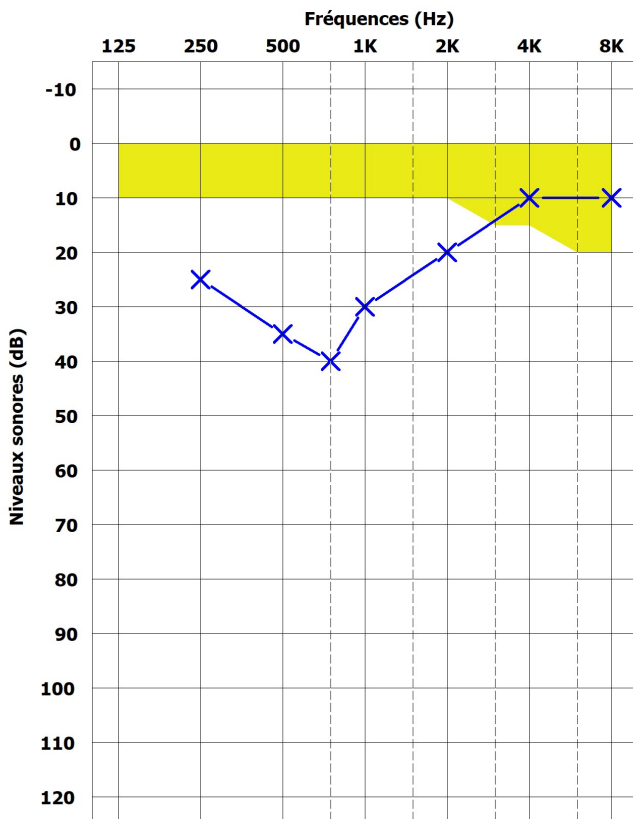

Oreille Gauche

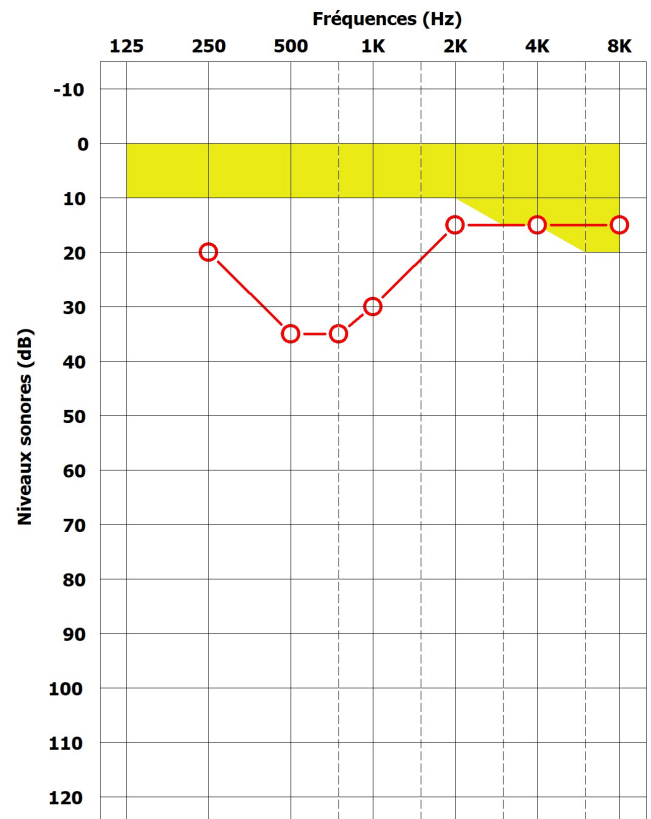

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	40	30		20		10		10
CA Droit		20	35	35	30		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes