


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 12:13:05
Durée: 4mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	CHEC
ID	24091412110566474

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

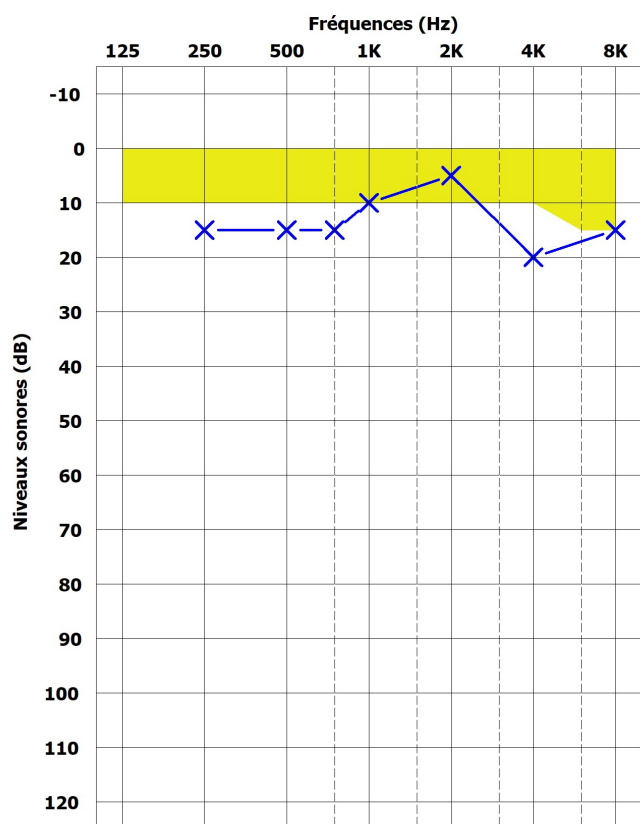

Oreille Gauche

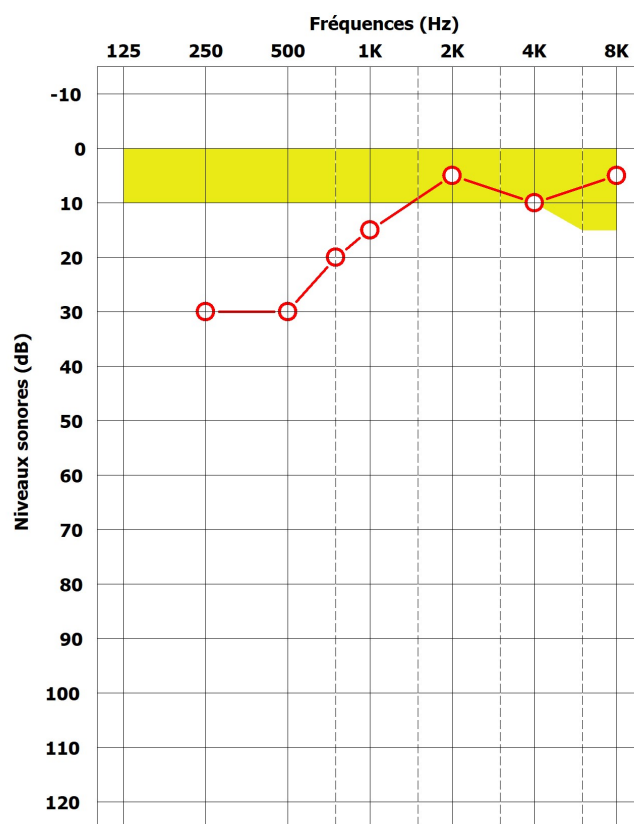

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	10		5		20		15
CA Droit		30	30	20	15		5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes