



Données Patient	
SYLLA YAMOUSSA	
Date de naissance	01/01/2005
Age	19
Société	CHEC
ID	24090810345346402

Date du test: 08/09/2024 10:36:47
Durée: 4mn 12s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

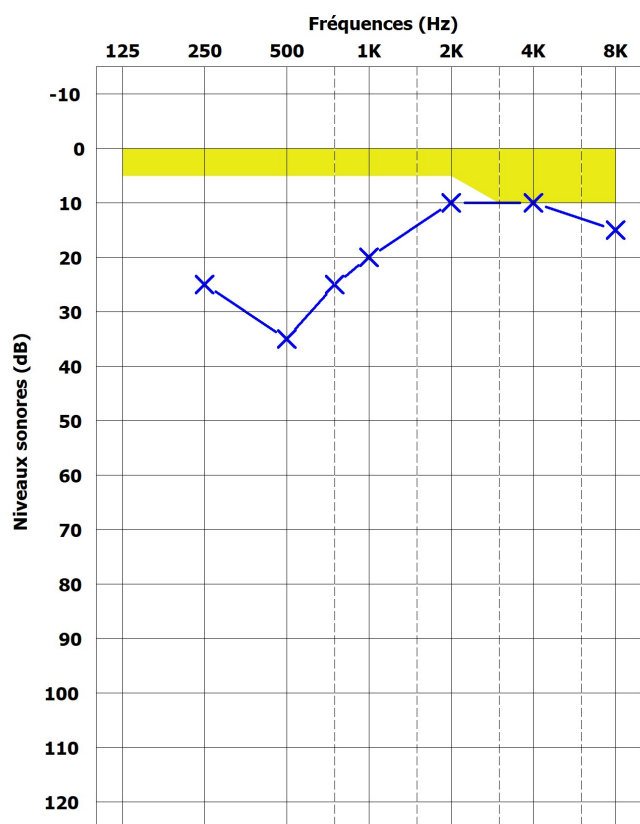

Oreille Gauche

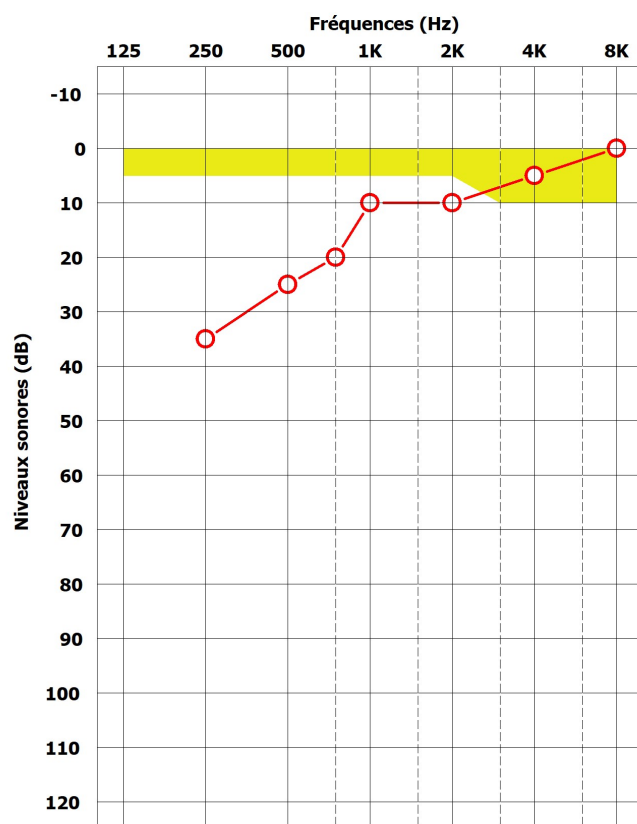

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	25	20		10		10		15
CA Droit		35	25	20	10		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes