

Données Patient


CISSE OUSMANE

Date de naissance 01/01/2005
Age 19
Société CHEC
ID 24092618593799385


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 26/09/2024 19:01:00
Durée: 4mn 24s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

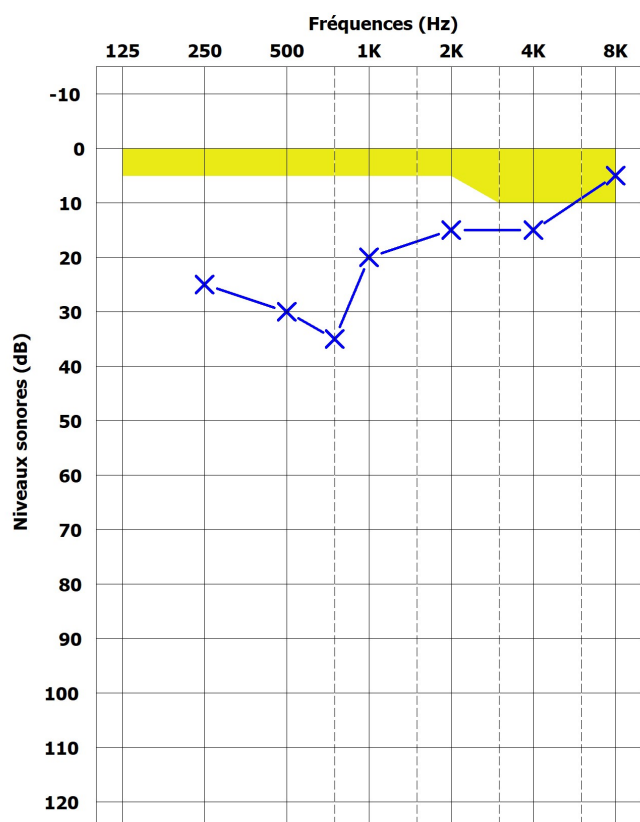

Oreille Gauche

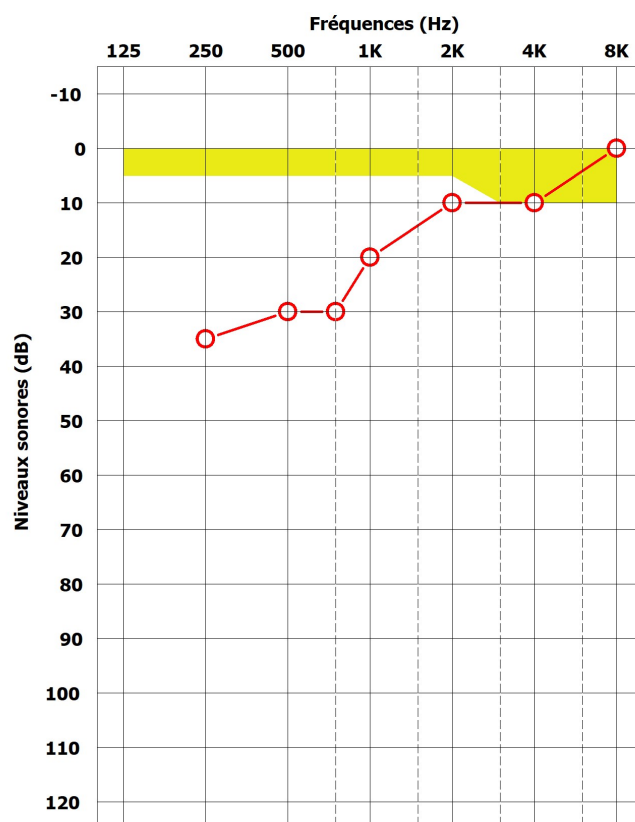

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	35	20		15		15		5
CA Droit		35	30	30	20		10		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes