


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 14:51:35
Durée: 3mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
JOSIAH MOHAMED	
Date de naissance	05/05/1983
Age	41
Société	CHEC
ID	24071714475987439

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

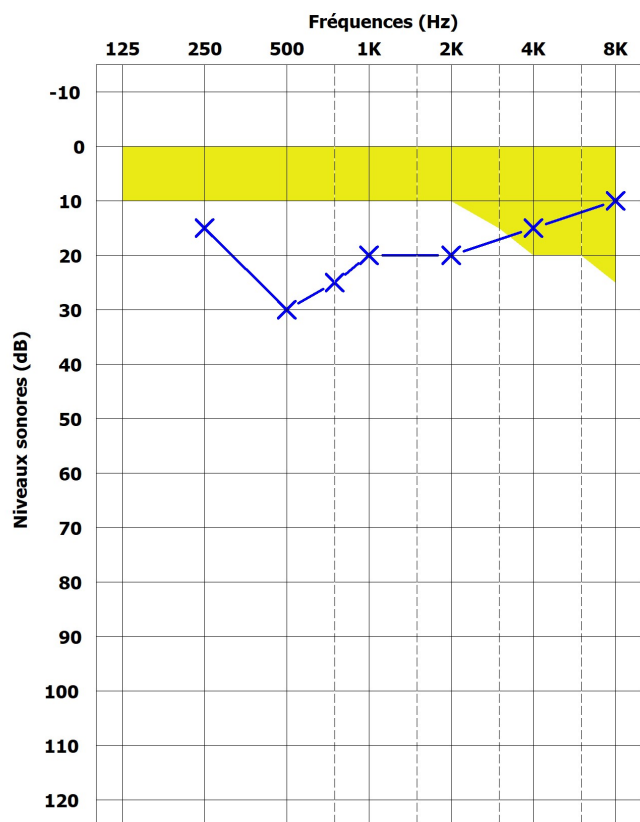

Oreille Gauche

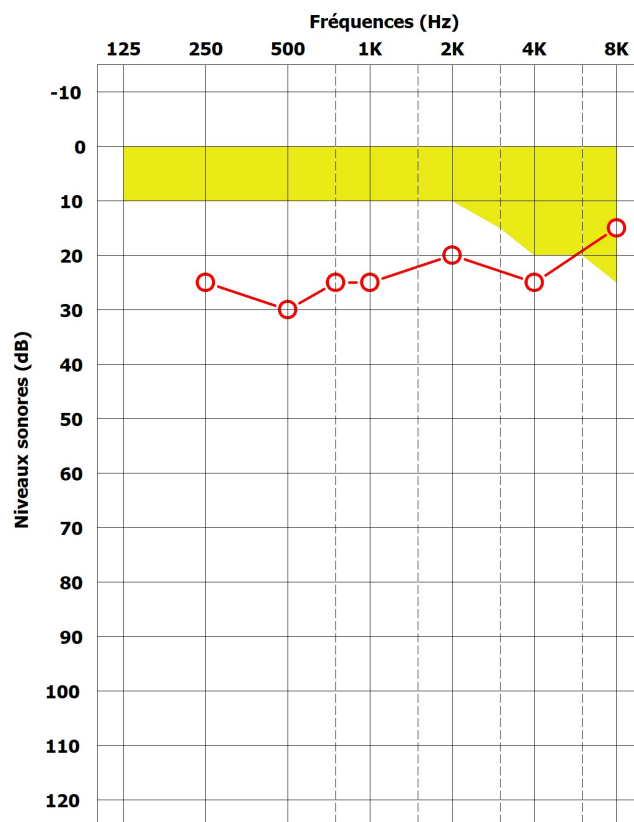

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	25	20		20		15		10
CA Droit		25	30	25	25		20		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes