

MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 17:56:13

Durée: 4mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOURE FODE BANGALY
Date de naissance	02/02/1984
Age	40
Société	CHEC
ID	24071717525750660

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

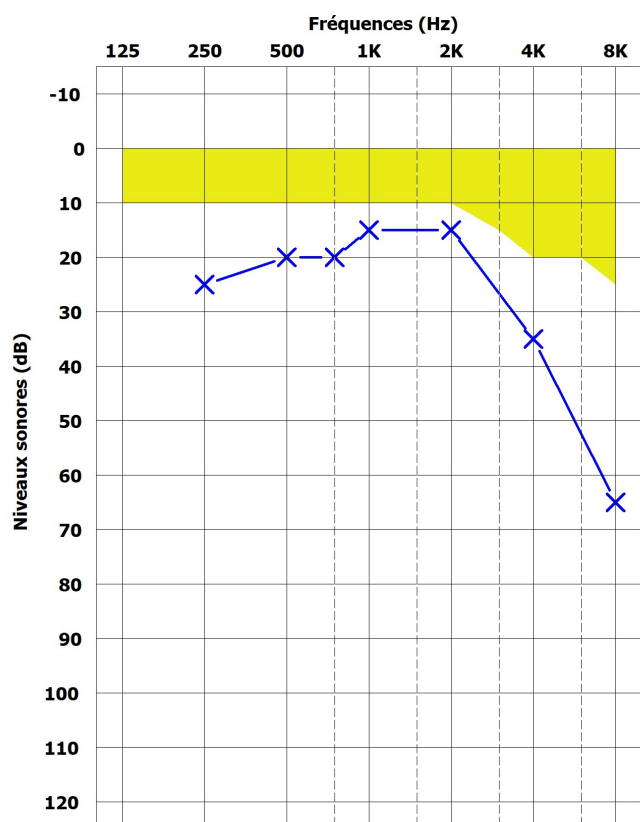

Oreille Gauche

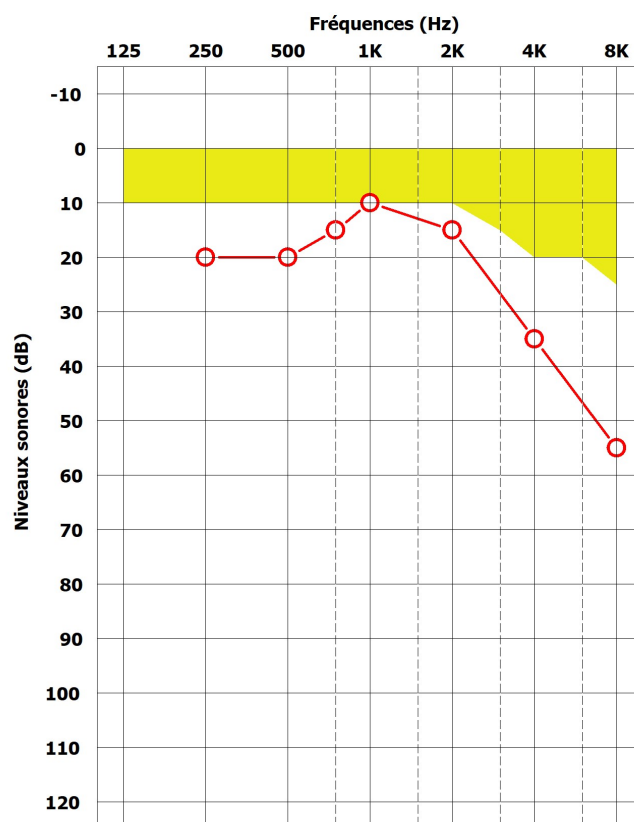

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	15		15		35		65
CA Droit		20	20	15	10		15		35		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes