


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 15:11:16
Durée: 4mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MANINGA RENE	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24072515080625628

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

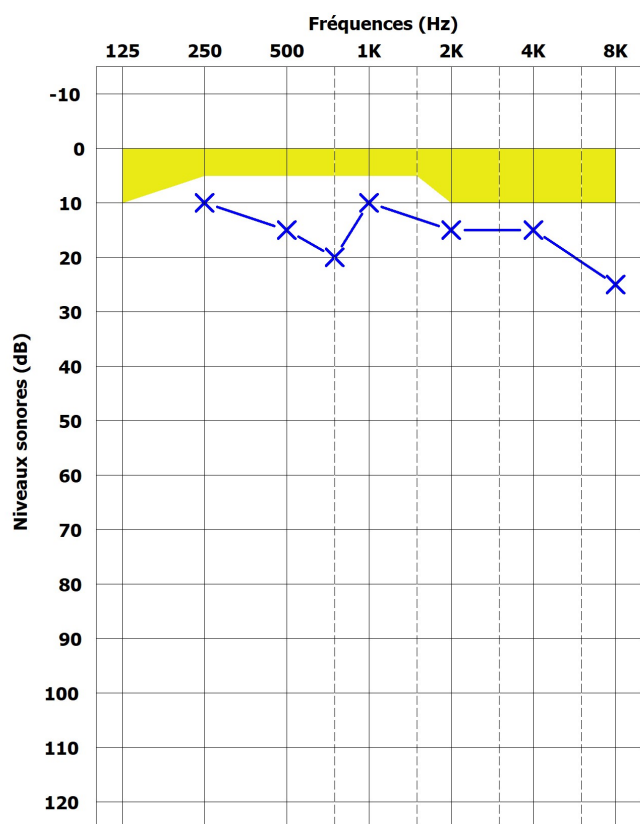

Oreille Gauche

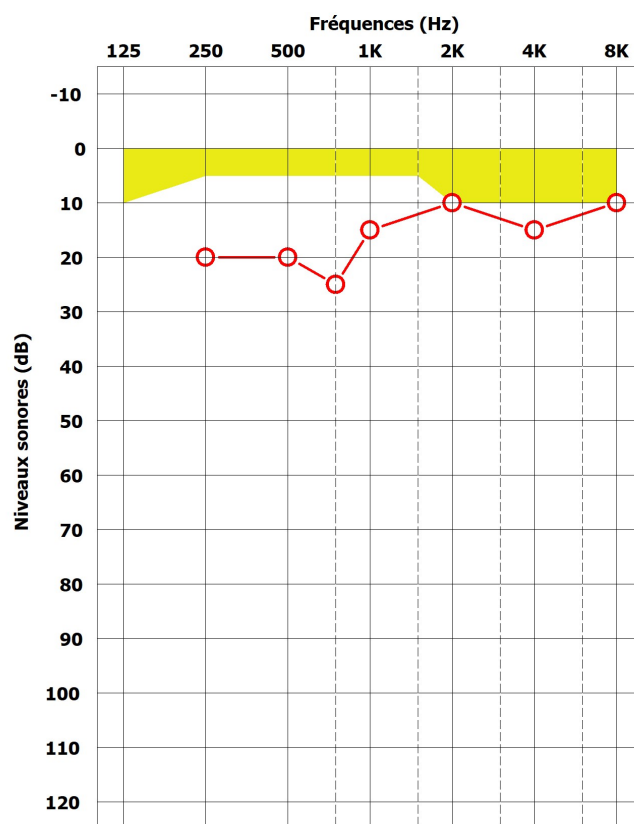

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	20	10		15		15		25
CA Droit		20	20	25	15		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes