

MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 17:05:26

Durée: 3mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CISSE MORY FODE	
Date de naissance	15/04/1981
Age	43
Société	CHEC
ID	24071517034793198

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

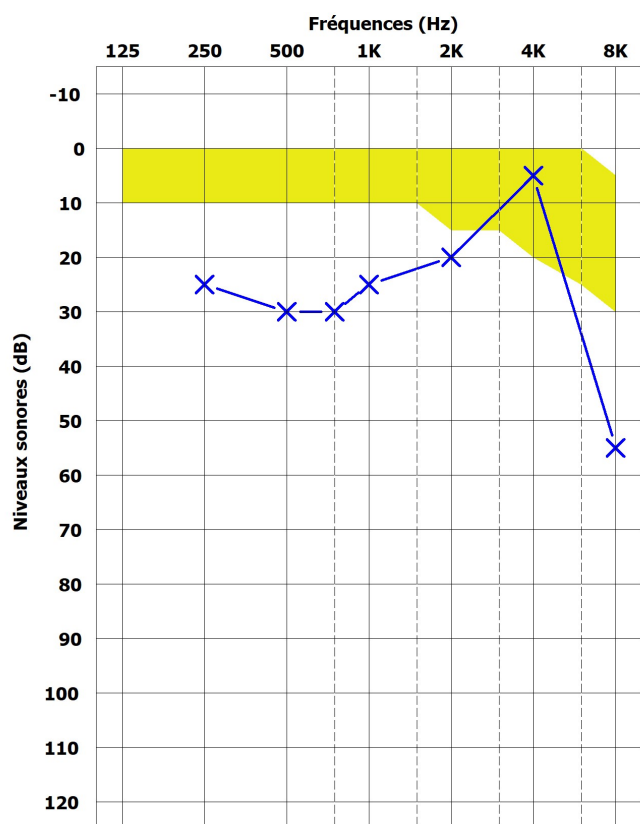

Oreille Gauche

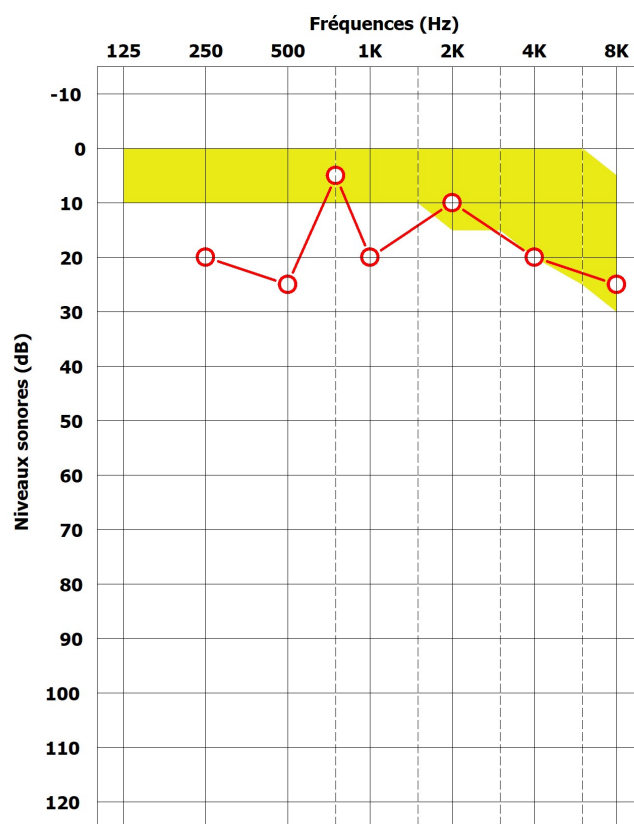

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	25		20		5		55
CA Droit		20	25	5	20		10		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes