



| Données Patient      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>MARA AUGUSTIN</b> |                   |
| Date de naissance    | 01/01/1997        |
| Age                  | 27                |
| Société              | CHEC              |
| ID                   | 24091414564987268 |

Date du test: 14/09/2024 15:03:05  
Durée: 4mn 49s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

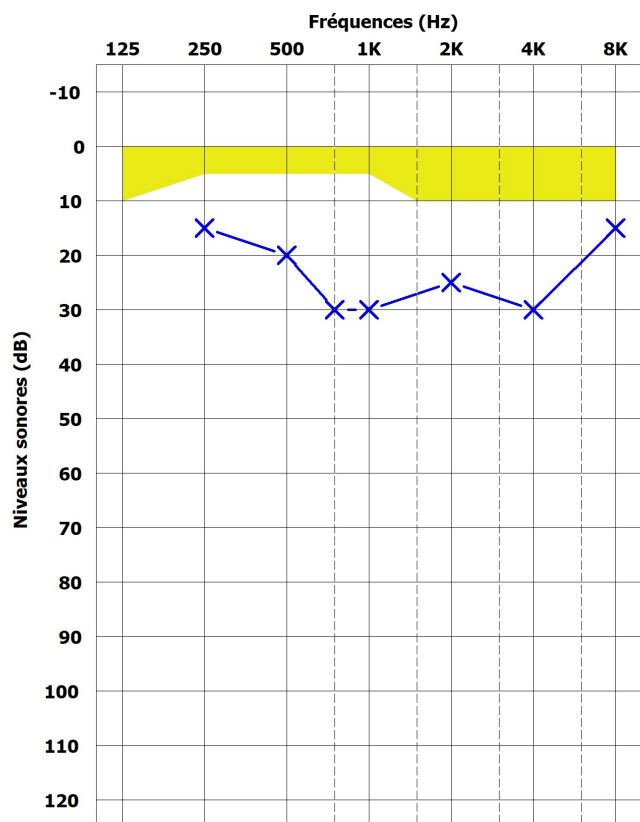

Oreille Gauche

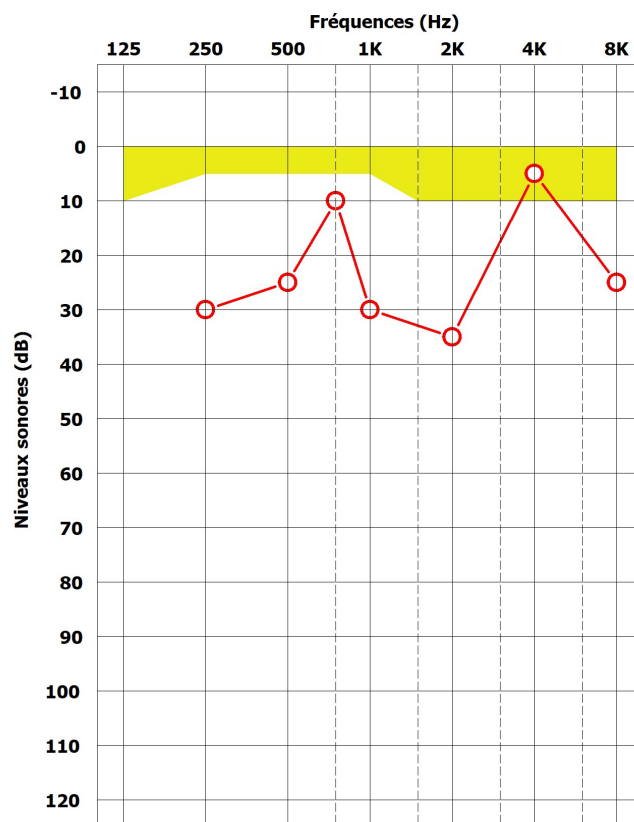

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 20  | 30  | 30 |     | 25 |    | 30 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 30  | 25  | 10  | 30 |     | 35 |    | 5  |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 26,3 dB | --- |
| CA Droit        | 23,8 dB | --- |

Notes