


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 13:13:28
Durée: 4mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SQUARE ALSENY
Date de naissance	03/04/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24080913041947295

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

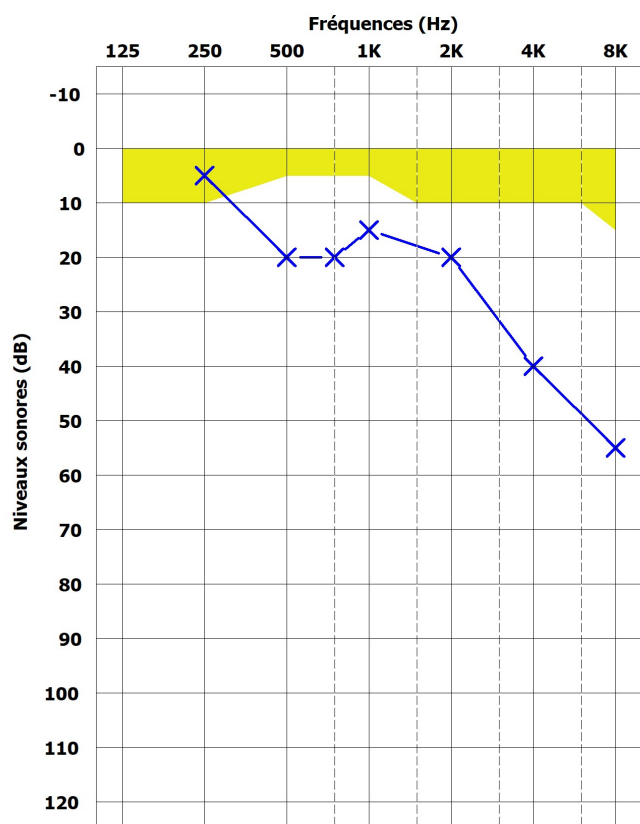

Oreille Gauche

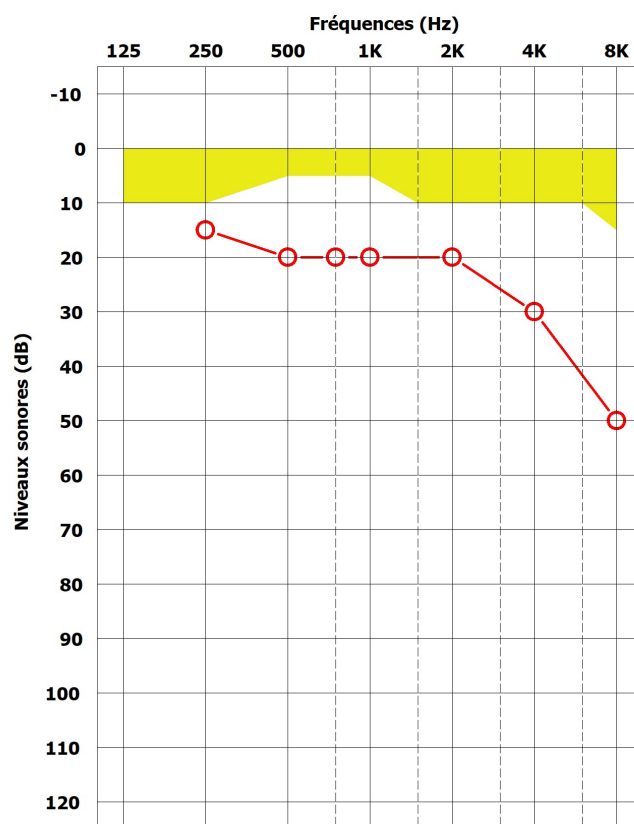

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	20	20	15		20		40		55
CA Droit		15	20	20	20		20		30		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes