

Données Patient


BANGOURA MAMADI OTIS

Date de naissance 26/10/1993
Age 30
Société CHEC
ID 24092515335798055


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 25/09/2024 15:35:34
Durée: 4mn 40s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

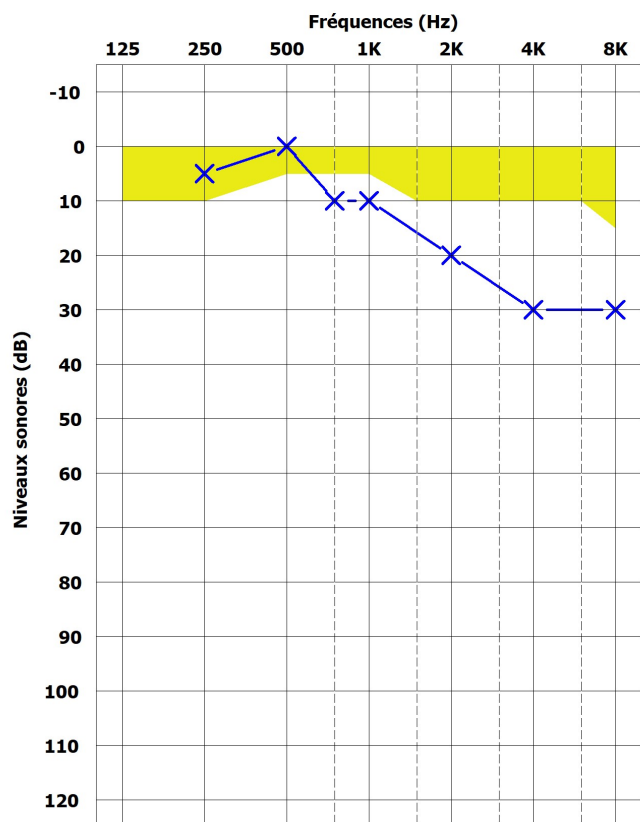

Oreille Gauche

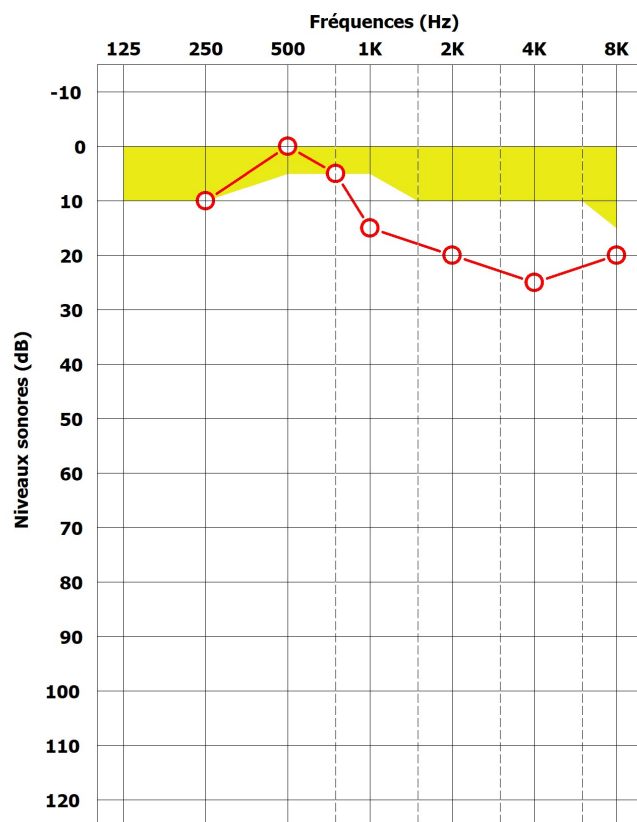

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	10	10		20		30		30
CA Droit		10	0	5	15		20		25		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes