


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 14:31:35
Durée: 2mn 23s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	SYLLA MUHAMED IRRAHIMA
Date de naissance	18/06/1998
Age	26
Société	CHEC
ID	24072514221049423

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

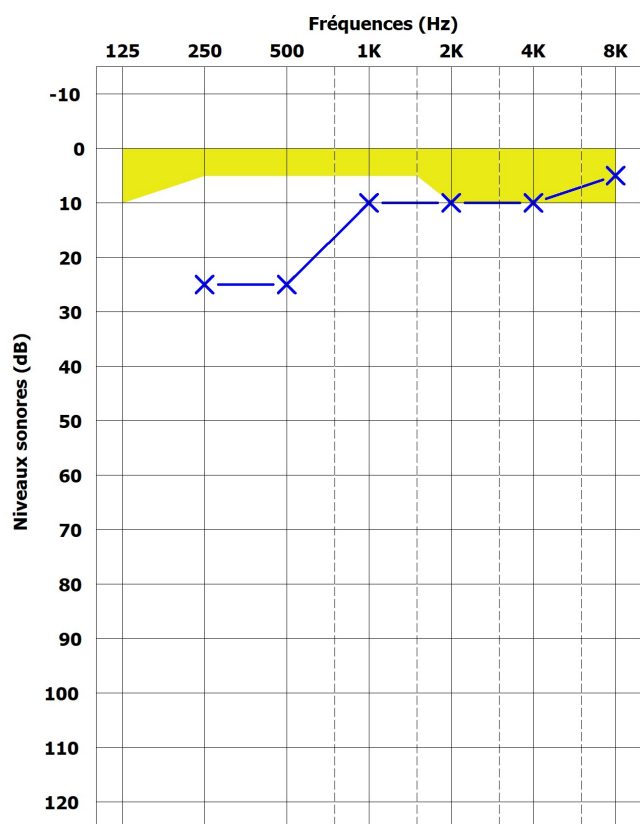

Oreille Gauche

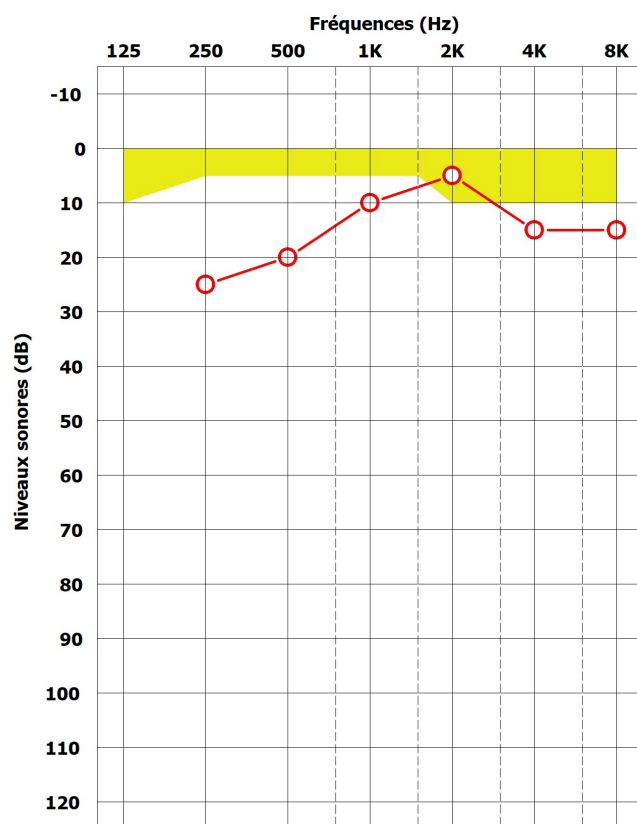

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		10		10		10		5
CA Droit		25	20		10		5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes