

MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 14:17:18

Durée: 5mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA FODE	
Date de naissance	26/06/1998
Age	26
Société	CHEC
ID	24080714214703917

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

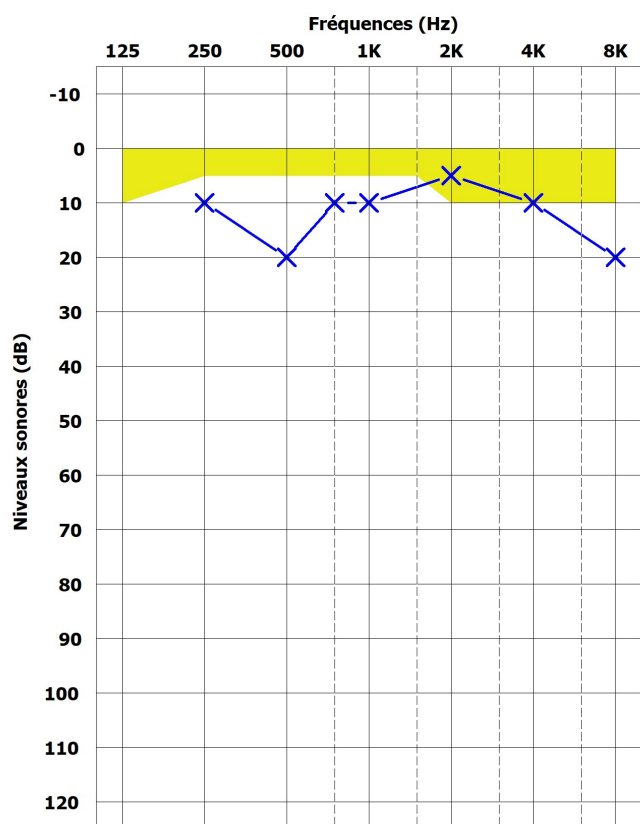

Oreille Gauche

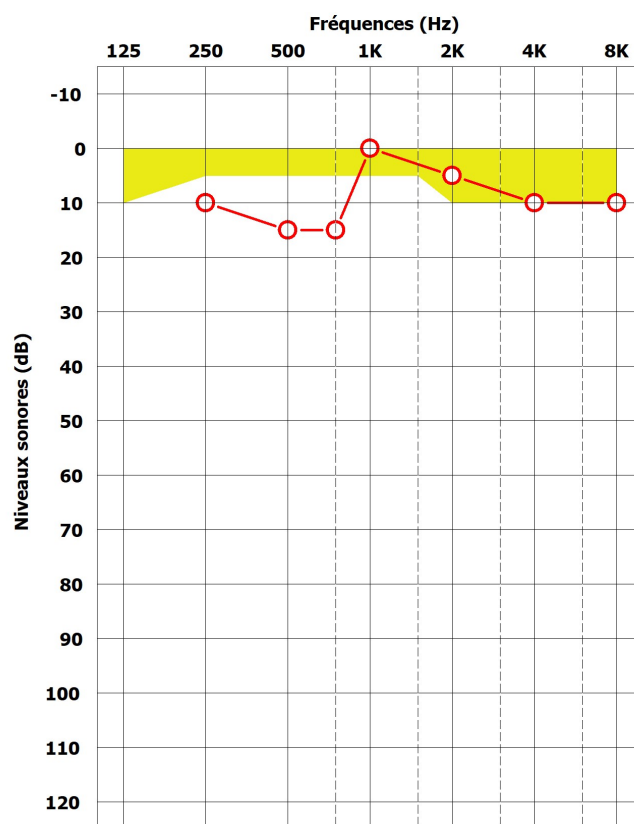

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	10	10		5		10		20
CA Droit		10	15	15	0		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes